

Steelcase®
HEALTH

Sonata™ - استبدال الجزء العلوي من وحدات الجزيرة أو وحدات خدمات المرضة أو وحدات الوسائط



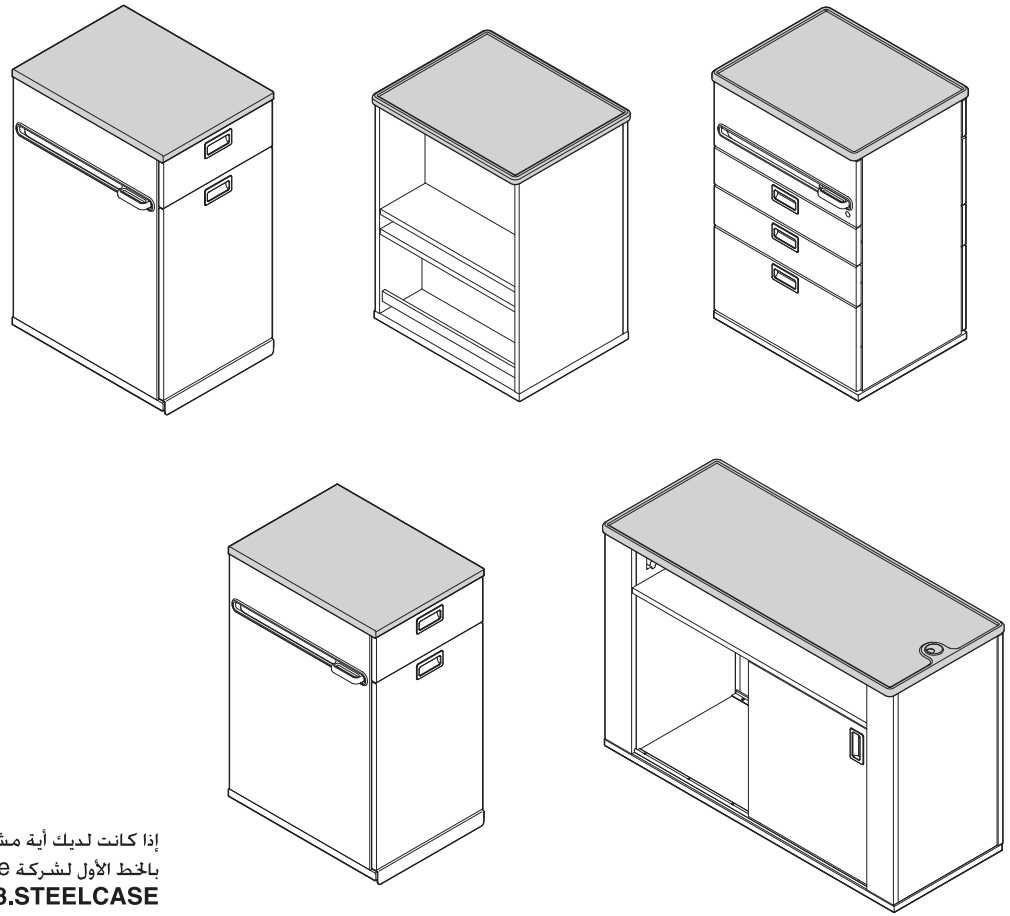



غراء خشب

إذا كانت لديك أية مشكلة أو سؤال أو طلب، اتصل بالتاجر المحلي لديك أو بالخط الأول لشركة Steelcase على الخط المجاني **888.STEELCASE** (888.783.3522) للحصول على استجابة فورية من الأشخاص الراغبين في مساعدتك.

(خارج الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك وبورتوريكو وجزر فرجن التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، يرجى الاتصال على الرقم: 1.616.247.2500) أو زيارة موقعنا الإلكتروني: www.steelcase.com


© جميع الحقوق لعام 2010 محفوظة لشركة Steelcase Inc.
جراند رابيدز، ميتشجن 49501
الولايات المتحدة الأمريكية

طُبع في الولايات المتحدة الأمريكية

Steelcase®
HEALTH

إزالة الجزء العلوي من وحدة خدمات
ممرضة أحادية الجانب

1- أزل اللوح الخلفي (1a) ثم أزل الأوتاد الخشبية المتبقية (1b).

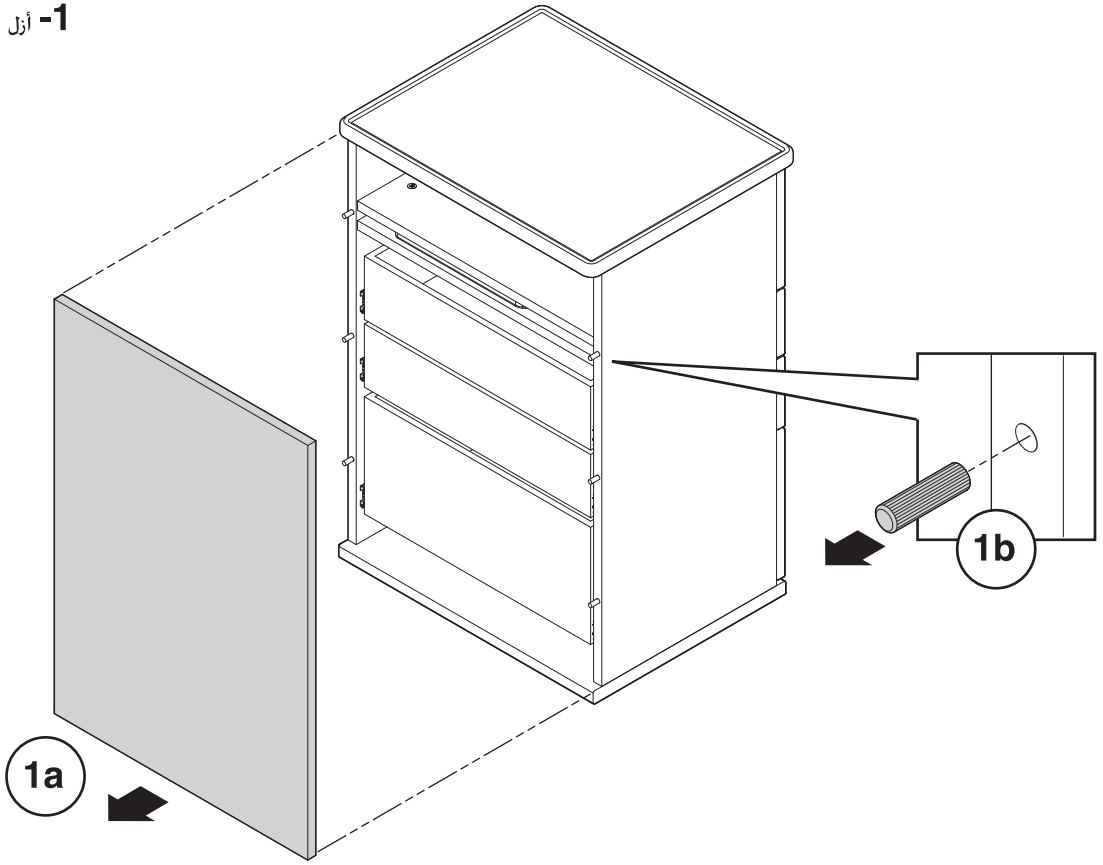


Steelcase®
HEALTH


2- حدد مواقع الأربع (4) كامات على الجانب الداخلي من وحدة خدمات الممرضة أحادية الجانب. أدِر قفل الكامة باستخدام مفكّ المسامير الملولبة 1/4 دورة إلى اليسار لتحرير مسمار الربط.


3- أخرج الجزء العلوي (3a). أزل الأوتاد الخشبية واستبدلها (3b) إذا لزم الأمر.


4- قم بتركيب جزء علوي جديد عبر تثبيت أربعة (4) مسامير مصوملة ذات كامات أولاً في الفتحات الموجودة على الجانب السفلي من الجزء العلوي.

5- أعد تركيب اللوح الخلفي. الذي تمت إزالته في الخطوة 1 باستخدام غراء الخشب على الأوتاد الخشبية.

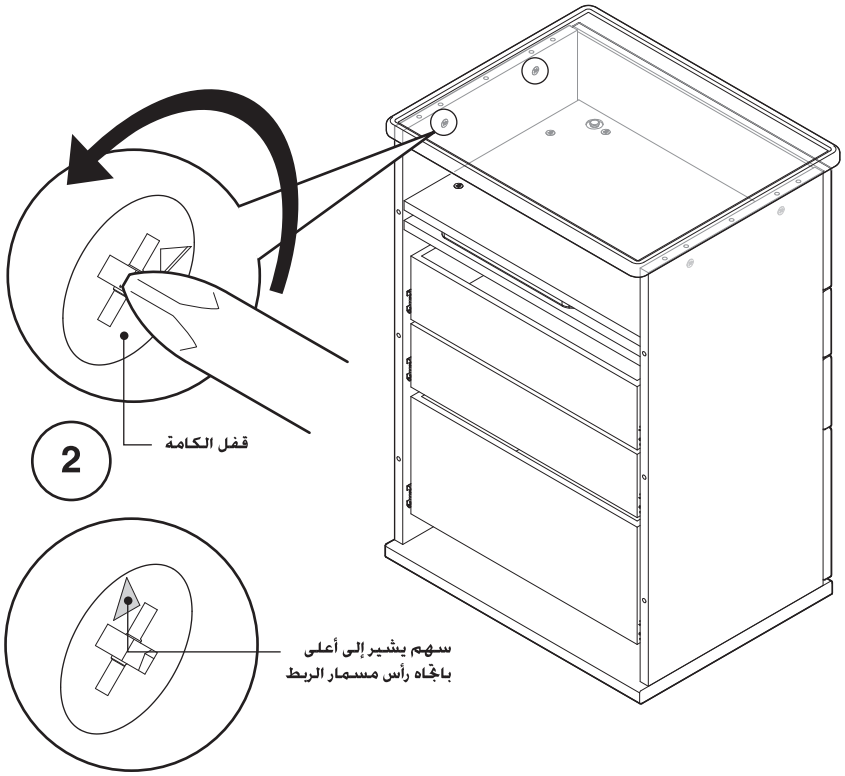

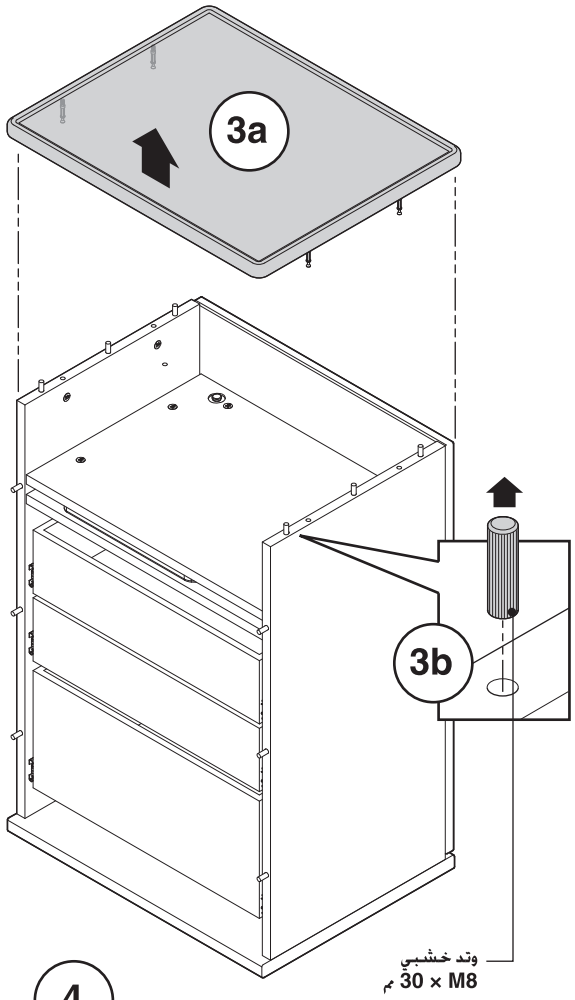

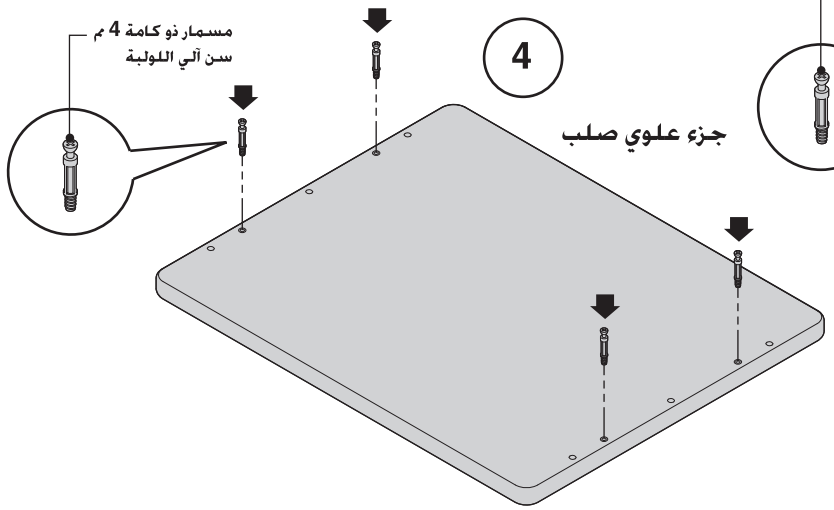

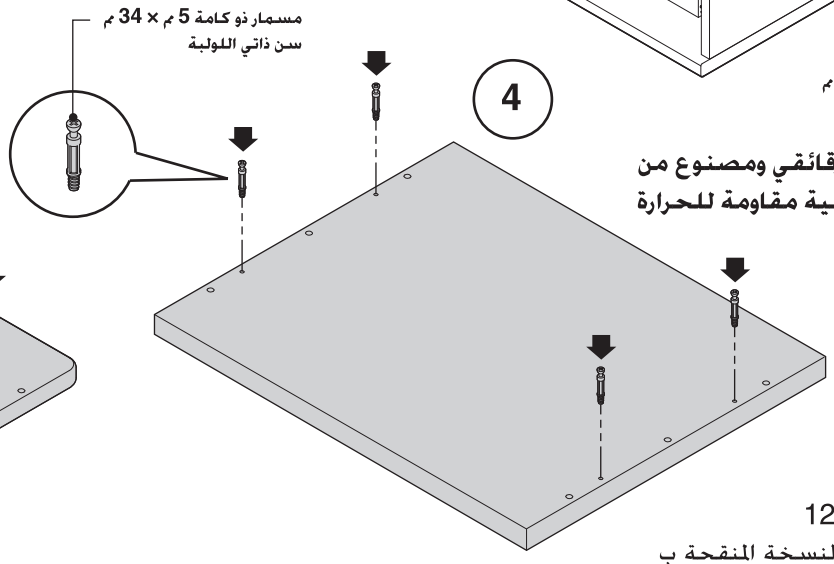

Steelcase®
HEALTH


إزالة الجزء العلوي من وحدة خدمات ممرضة ثنائية الجانب


1- ادفع اللسان على كلا جانبيّ الدرج وأخرج الدرج العلوي.


2- حدد موقع الكامات الأربع (4) على جانبيّ وحدة خدمات الممرضة. أدِر قفل الكامة باستخدام مفكّ المسامير الملولبة 1/4 دورة إلى اليسار لتحرير مسمار الربط.

3- أخرج الجزء العلوي (3a). أزل الأوتاد الخشبية واستبدلها (3b) إذا لزم الأمر.

4- قم بتركيب جزء علوي جديد عبر تثبيت أربعة (4) مسامير مصومولة ذات كامات أولاً في الفتحات الموجودة على الجانب السفلي من الجزء العلوي كما هو موضّح في الصفحة 3.

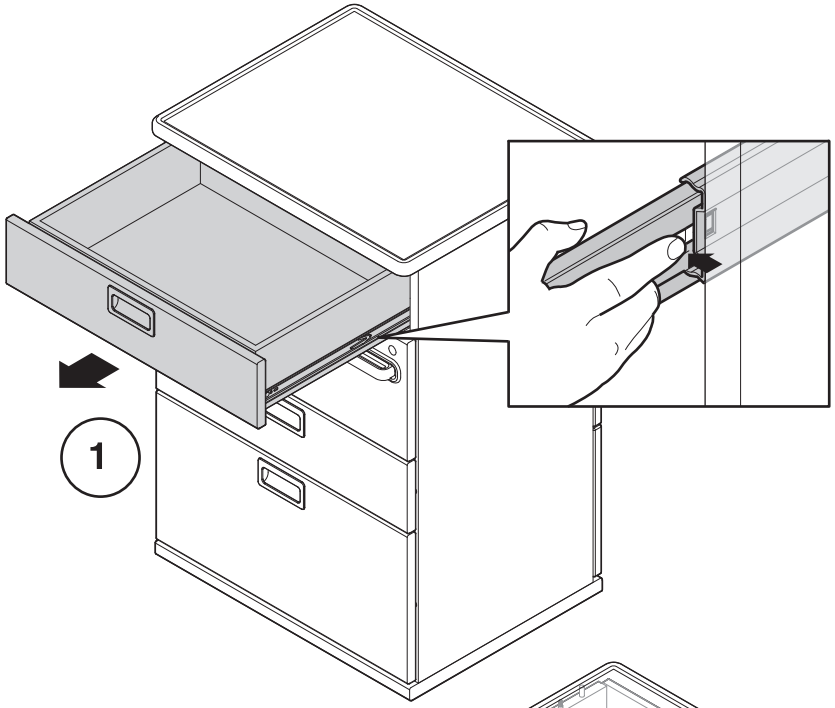

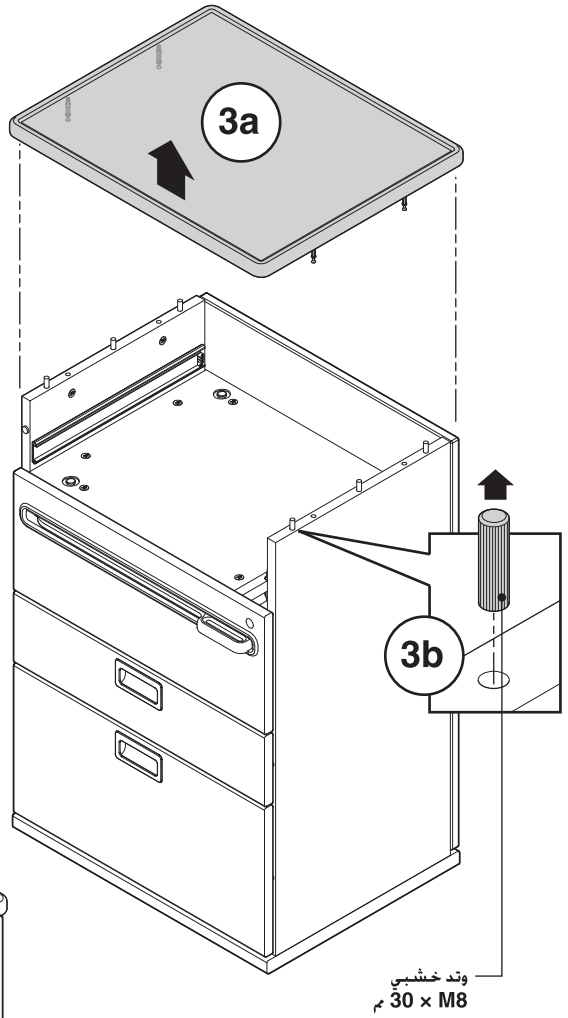

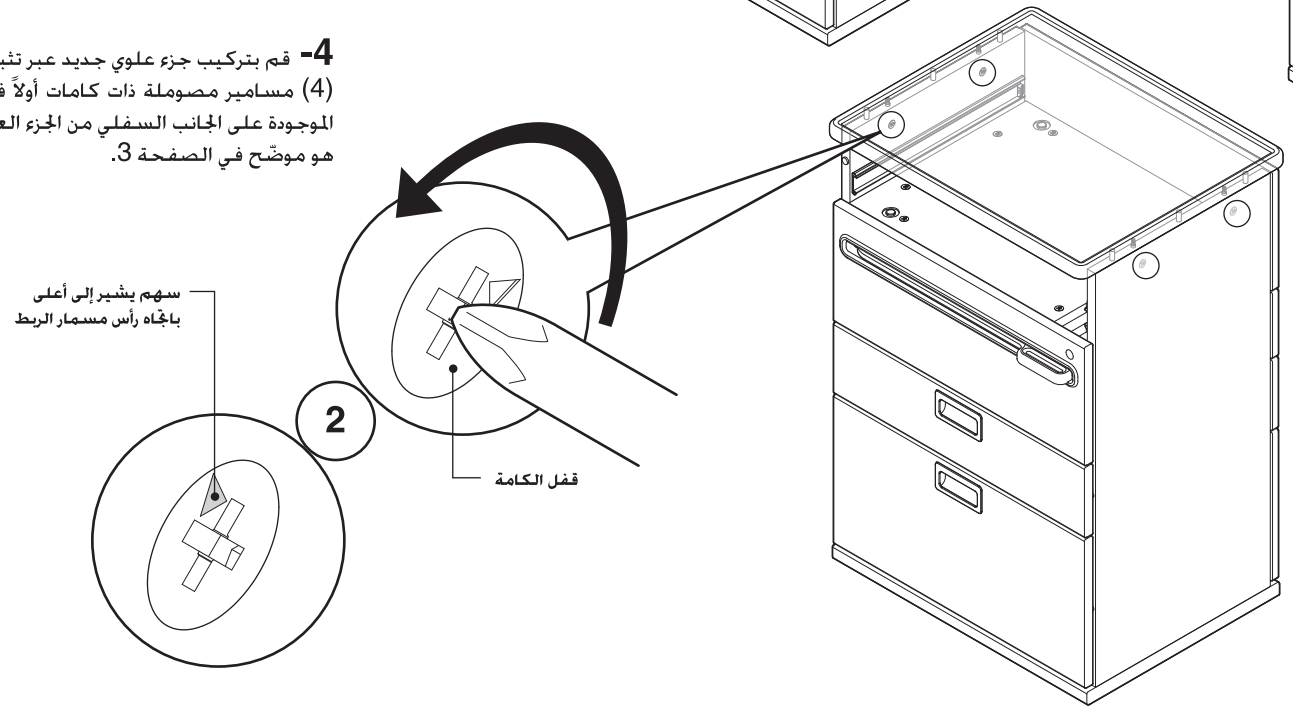

Steelcase®
HEALTH


إزالة الجزء العلوي من وحدة خدمات ممرضة مزوّدة بحاوية نفايات


1- ادفع اللسان على كلا جانبيّ الدرج وأخرج الدرج العلوي.


2- حدد موقع الكامات الخمس (5) على جانبيّ وحدة خدمات الممرضة والجزء الخلفي منها. أدِر قفل الكامة باستخدام مفكّ المسامير الملولبة 1/4 دورة إلى اليسار لتحرير مسمار الربط.

3- أخرج الجزء العلوي (3a). أزل الأوتاد الخشبية واستبدلها (3b) إذا لزم الأمر.

4- قم بتركيب جزء علوي جديد عبر تثبيت خمسة (5) مسامير مصوملة ذات كامات أولاً في الفتحات الموجودة على الجانب السفلي من الجزء العلوي كما هو موضّح في الصفحة 3.

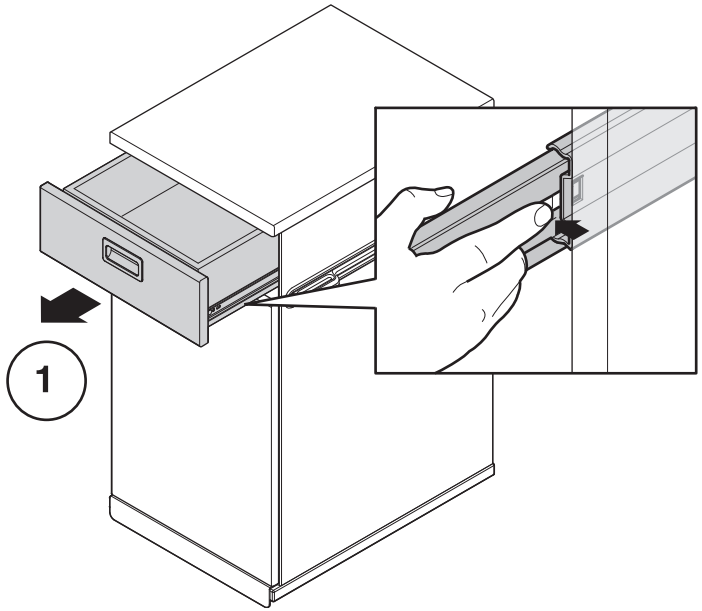

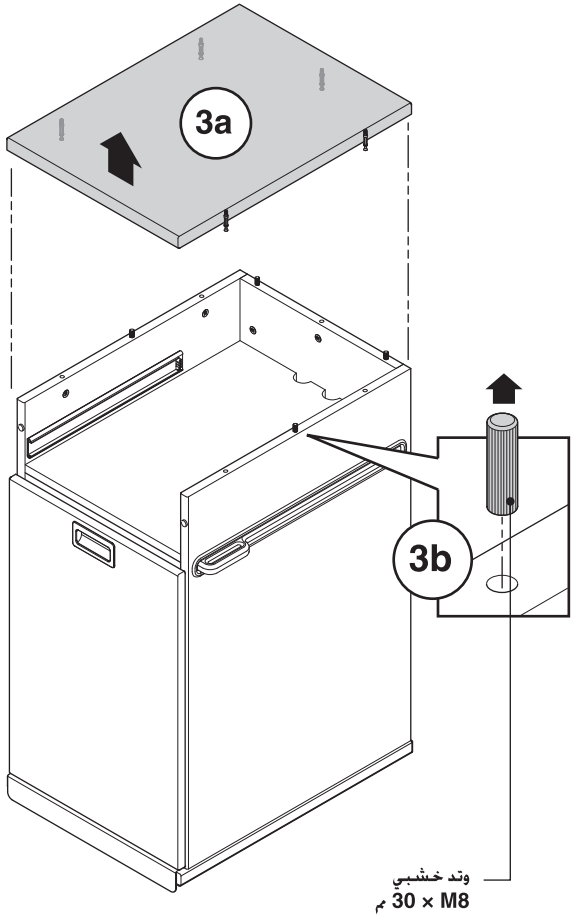

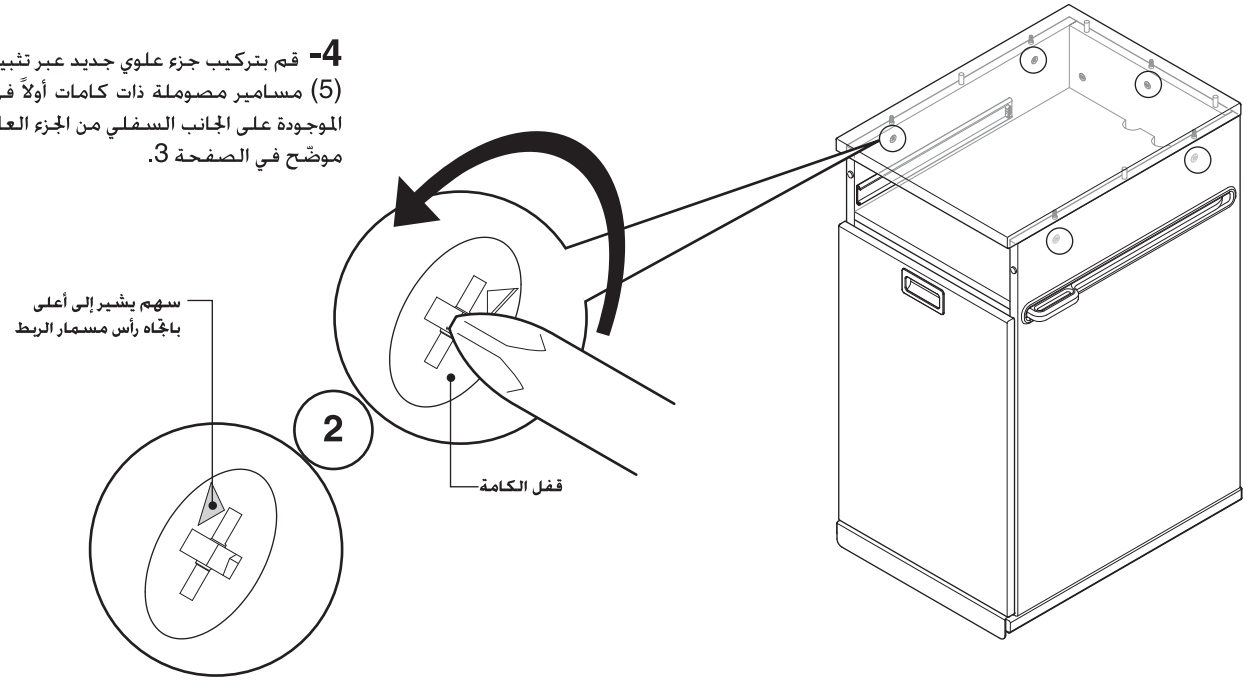


Steelcase®
HEALTH


إزالة الجزء العلوي من وحدة جزيرة ثنائية الجانب

1- حدد مواقع الأربع (4) كامات على الجانب الداخلي من الجزيرة. أدِر قفل الكامة باستخدام مفكّ المسامير الملولبة 1/4 دورة إلى اليسار لتحرير مسمار الربط.

2- أخرج الجزء العلوي (2a). أزل الأوتاد الخشبية واستبدلها (2b) إذا لزم الأمر.

3- قم بتركيب جزء علوي جديد عبر تثبيت أربعة (4) مسامير مصوملة ذات كامات أولاً في الفتحات الموجودة على الجانب السفلي من الجزء العلوي كما هو موضّح في الصفحة 3.

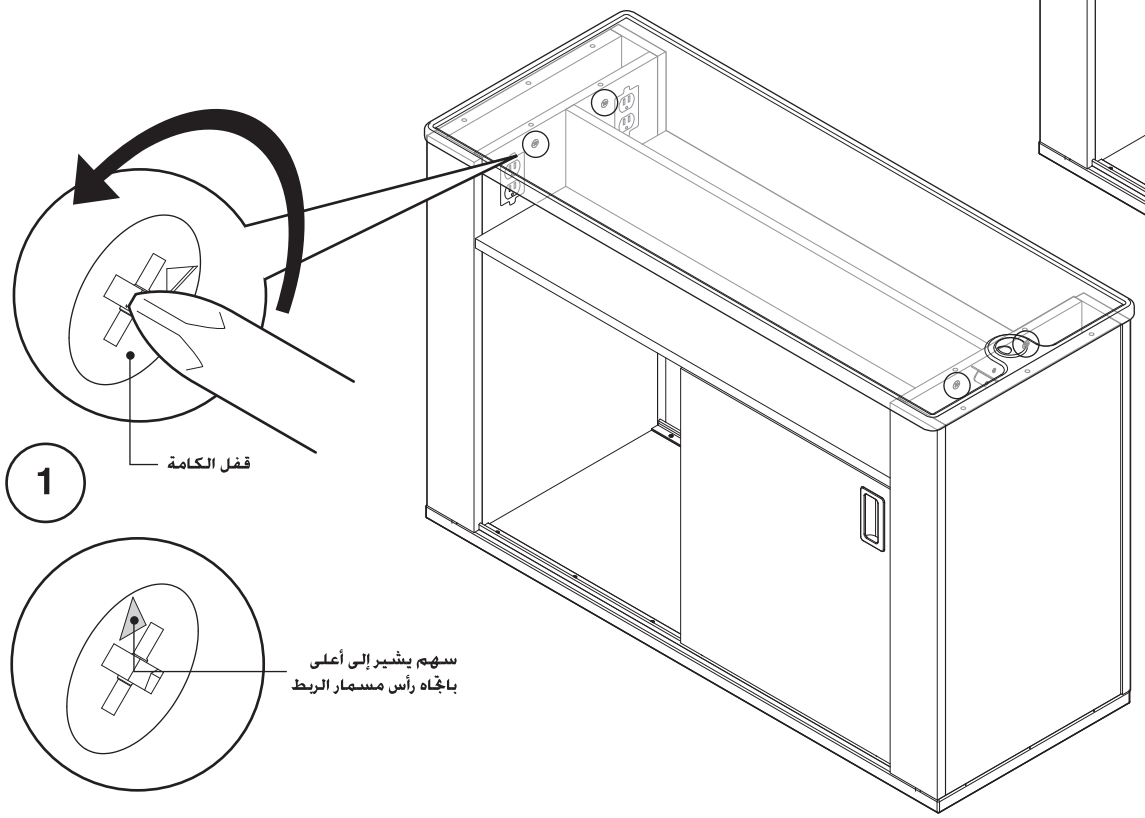

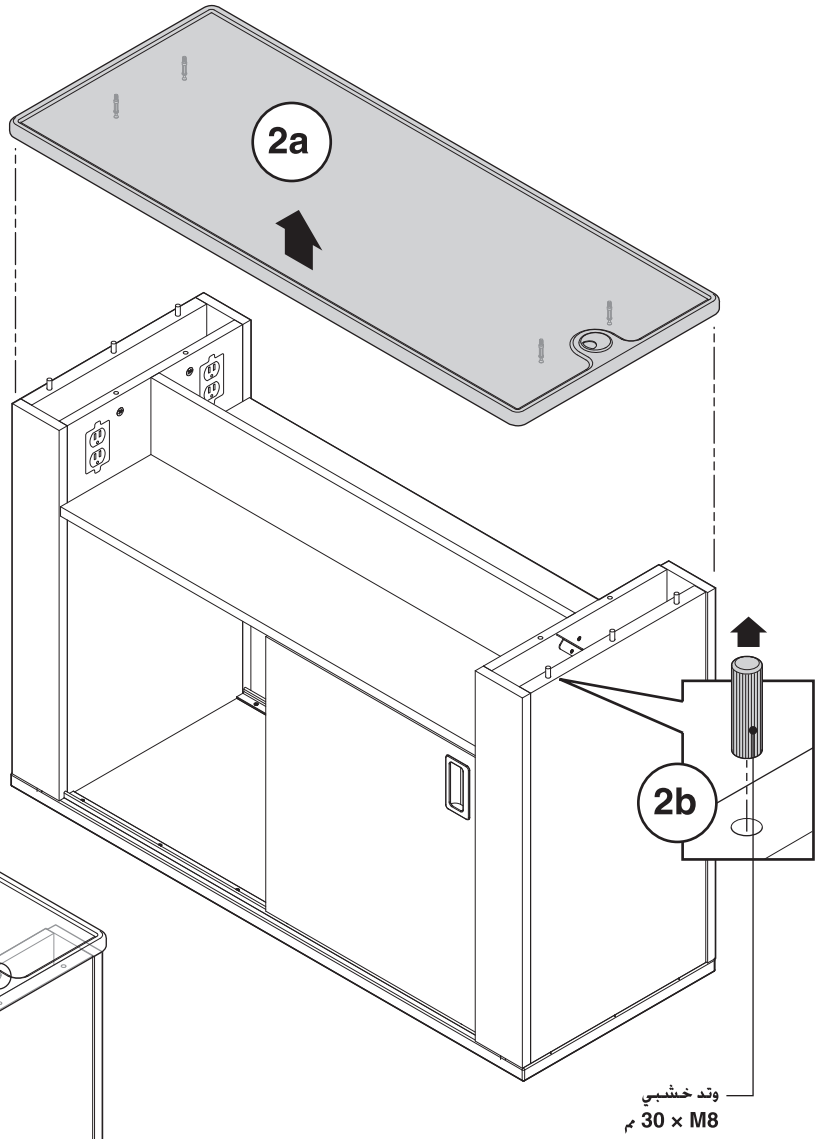


Steelcase®
HEALTH


إزالة الجزء العلوي من وحدة جزيرة ثنائية الجانب مقاس 36 بوصة

1- حدد مواقع الأربع (4) كامات على الجانب الداخلي من الجزيرة. أدِر قفل الكامة باستخدام مفكّ المسامير الملولبة 1/4 دورة إلى اليسار لتحرير مسمار الربط.

2- أخرج الجزء العلوي (2a). أزل الأوتاد الخشبية واستبدلها (2b) إذا لزم الأمر.

3- قم بتركيب جزء علوي جديد عبر تثبيت أربعة (4) مسامير مصوملة ذات كامات أولاً في الفتحات الموجودة على الجانب السفلي من الجزء العلوي كما هو موضّح في الصفحة 3.

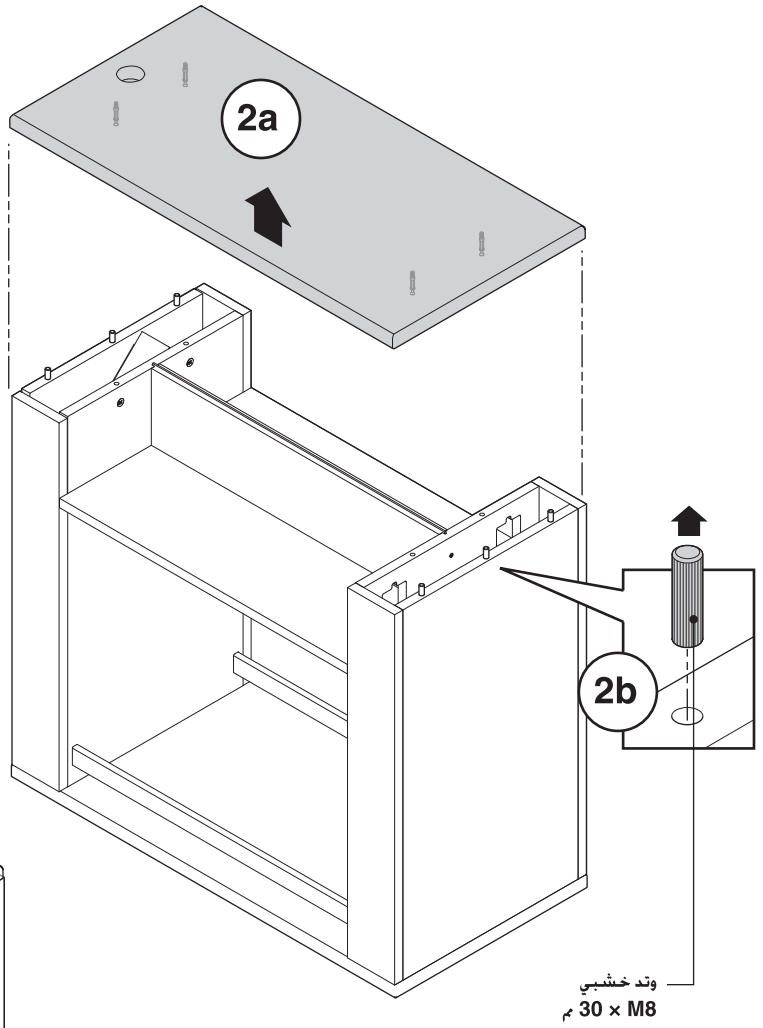

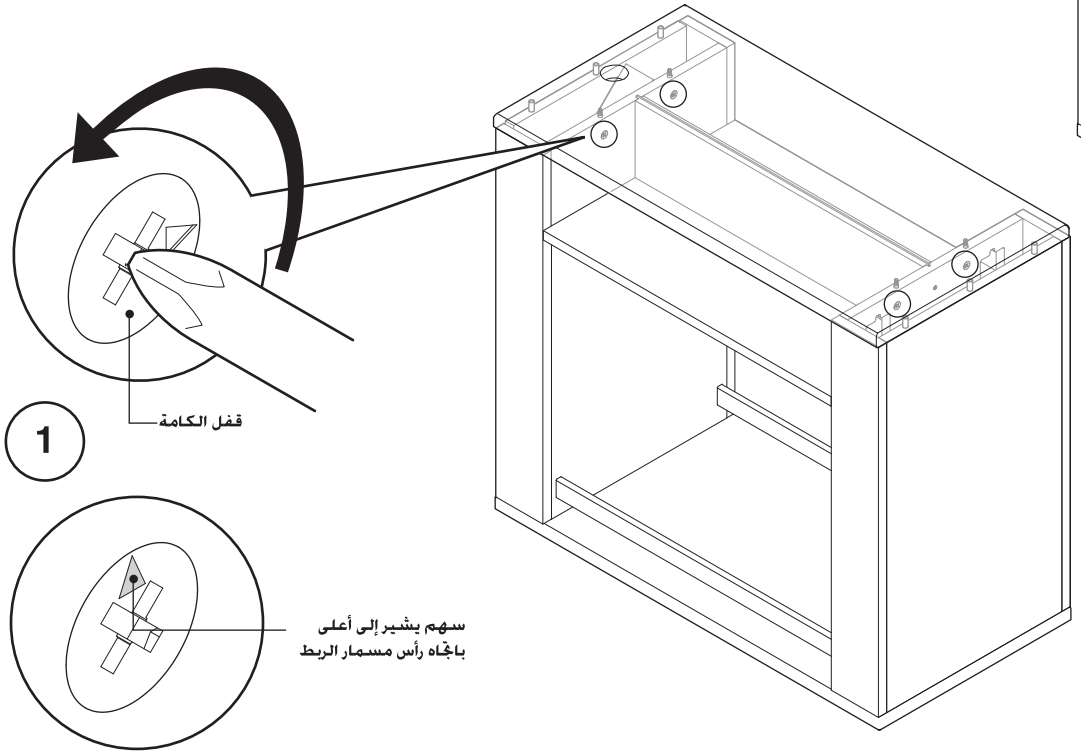


Steelcase®
HEALTH


إزالة الجزء العلوي من وحدة جزيرة أحادية الجانب

1- حدد مواقع الأربع (4) كامات على الجانب الداخلي من الجزيرة أحادية الجانب. أدِر قفل الكامة باستخدام مفكّ المسامير الملولبة 1/4 دورة إلى اليسار لتحرير مسمار الربط.

2- أخرج الجزء العلوي (2a). أزل الأوتاد الخشبية واستبدلها (2b) إذا لزم الأمر.

3- قم بتركيب جزء علوي جديد عبر تثبيت أربعة (4) مسامير مصوملة ذات كامات أولاً في الفتحات الموجودة على الجانب السفلي من الجزء العلوي كما هو موضّح في الصفحة 3.

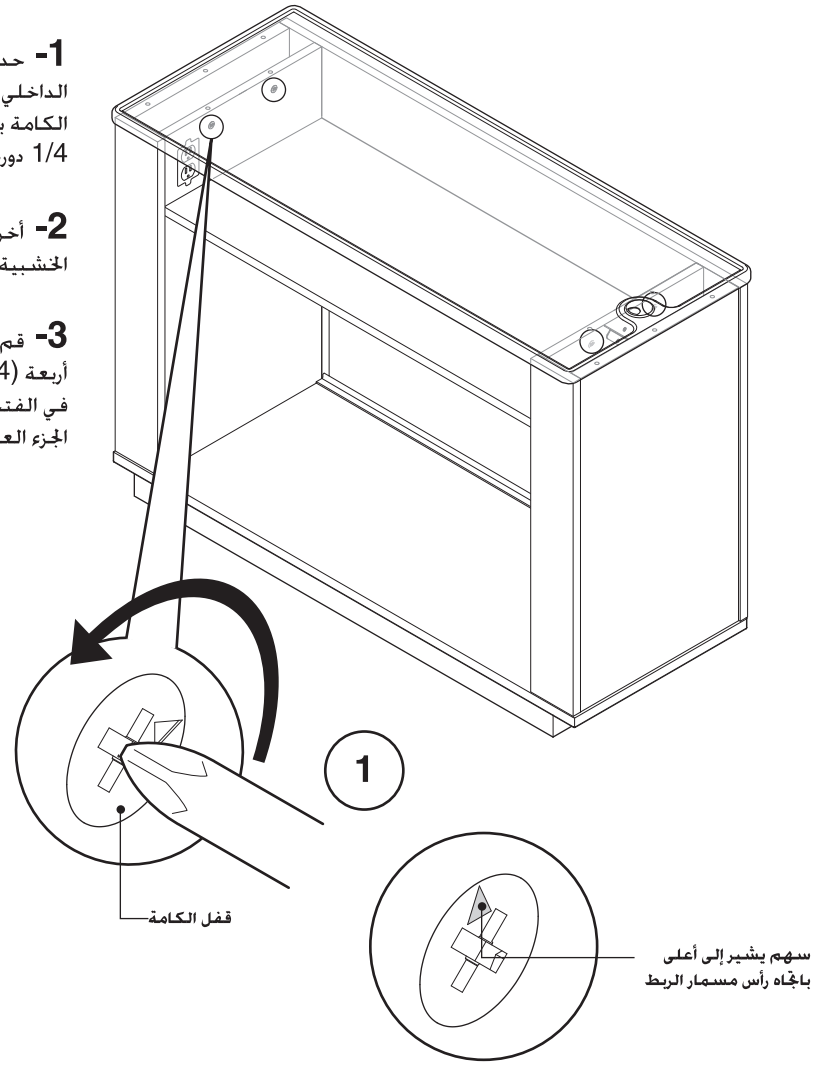

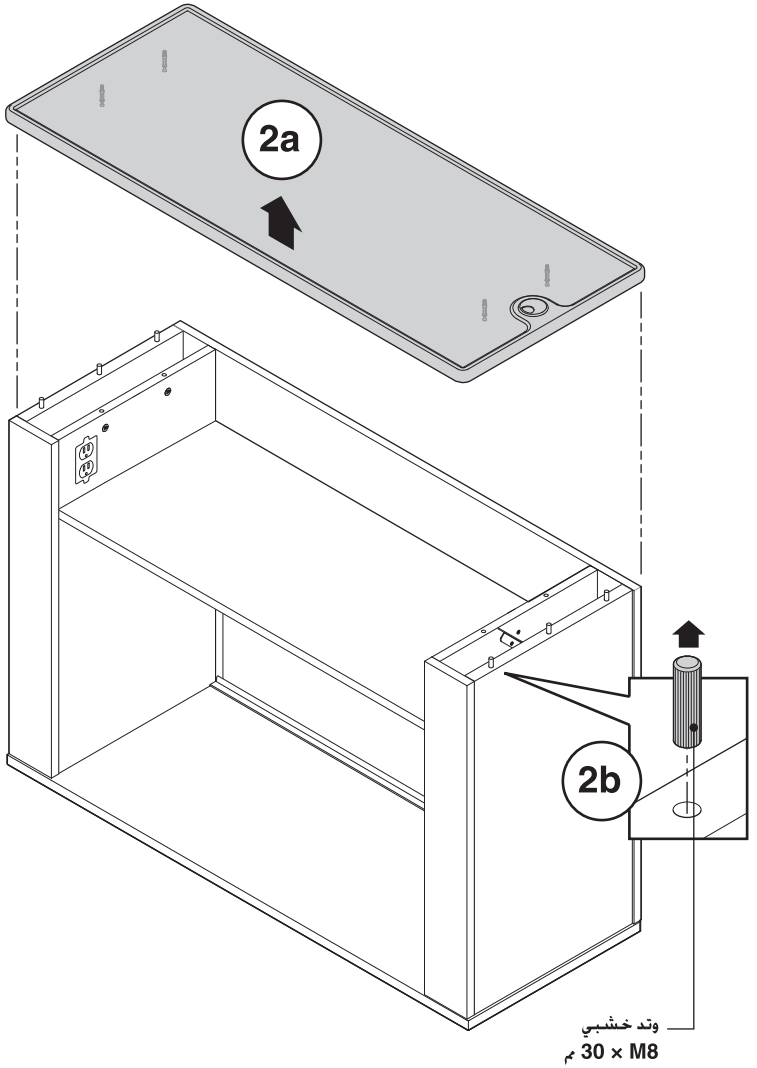


Steelcase®
HEALTH


إزالة الجزء العلوي من وحدة جزيرة أحادية الجانب مقاس 36 بوصة

1- حدد مواقع الأربع (4) كامات على الجانب الداخلي من الجزيرة أحادية الجانب مقاس 36 بوصة. أدر قفل الكامة باستخدام مفكّ المسامير الملولبة 1/4 دورة إلى اليسار لتحرير مسمار الربط.

2- أخرج الجزء العلوي (2a). أزل الأوتاد الخشبية واستبدلها (2b) إذا لزم الأمر.

3- قم بتركيب جزء علوي جديد عبر تثبيت أربعة (4) مسامير مصوملة ذات كامات أولاً في الفتحات الموجودة على الجانب السفلي من الجزء العلوي كما هو موضّح في الصفحة 3.

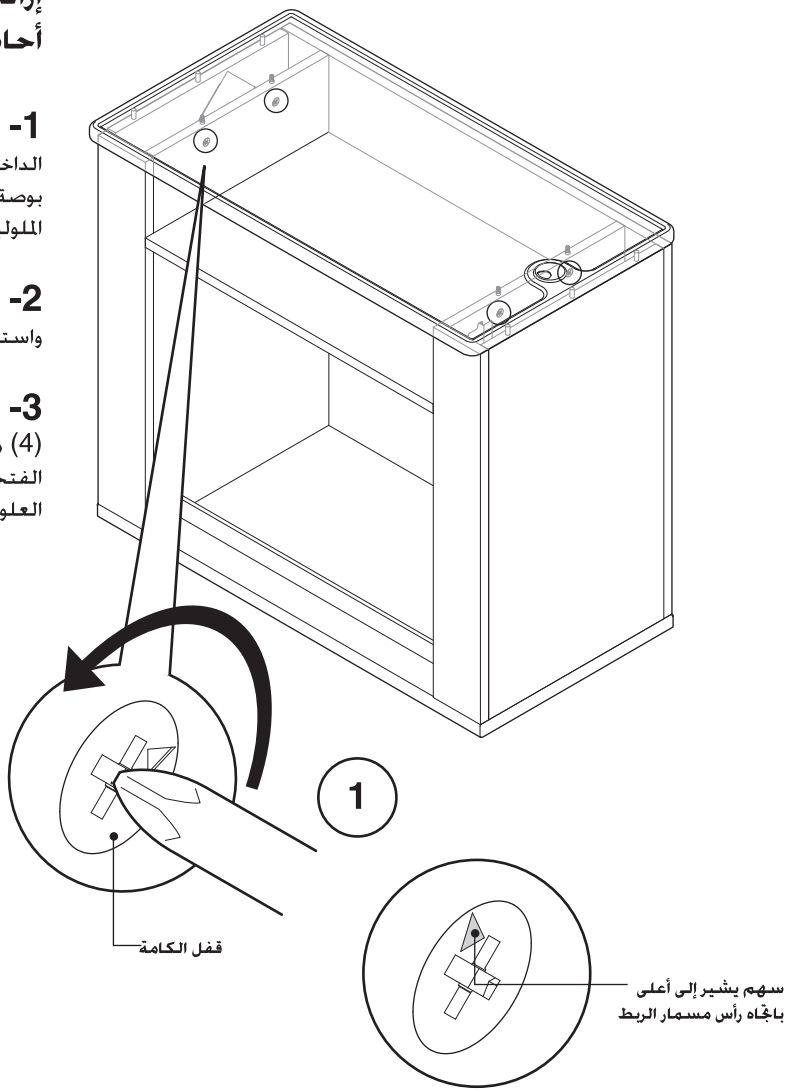


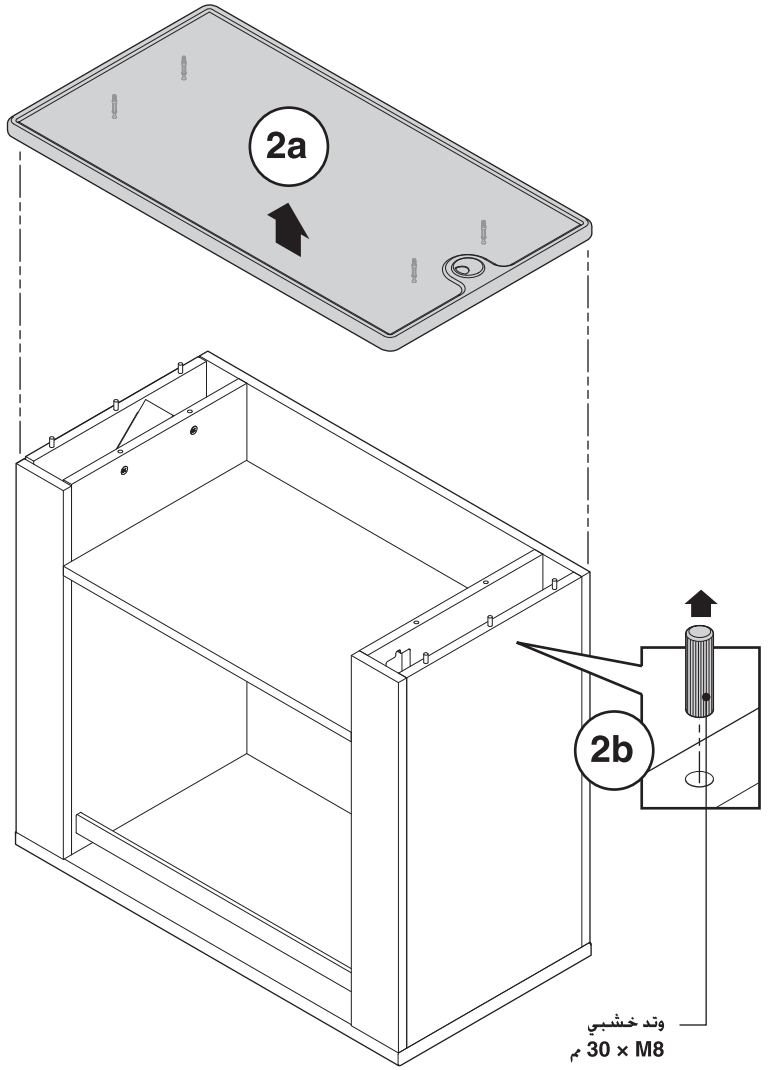

Steelcase®
HEALTH

إزالة الجزء العلوي من وحدة وسائط أحادية الجانب

1- أزل اللوح الخلفي (1a) ثم أزل الأوتاد الخشبية المتبقية (1b).

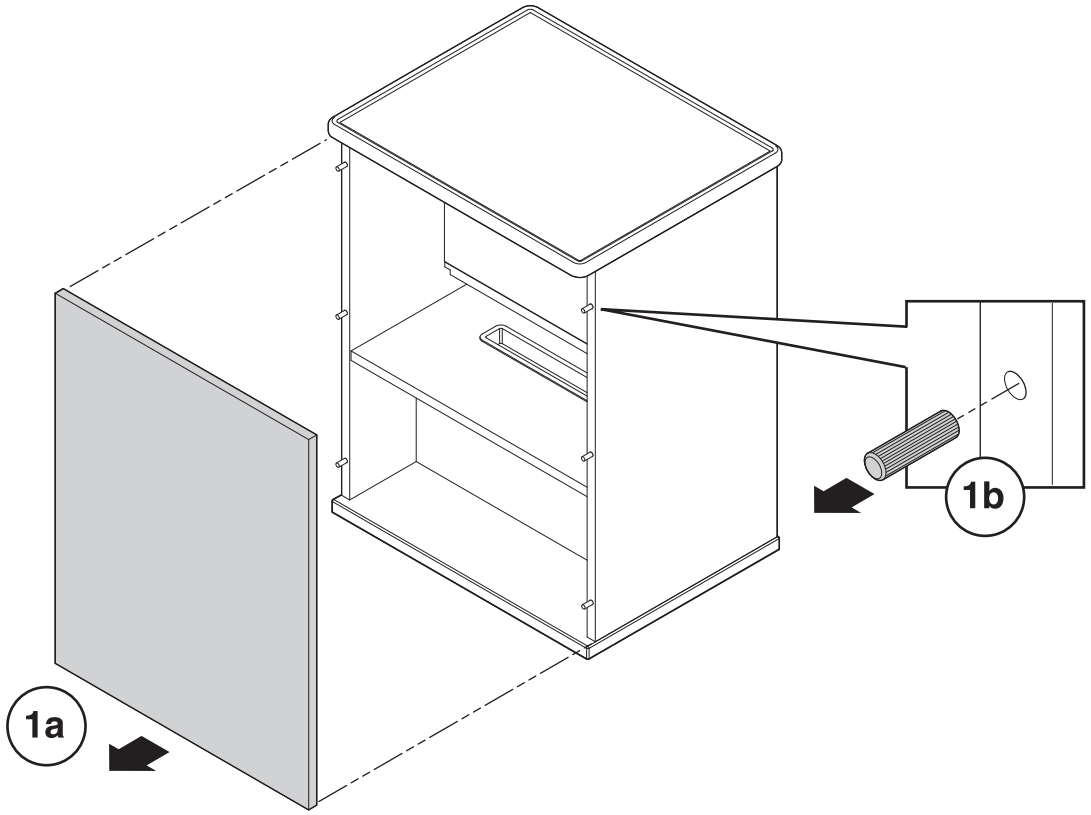


Steelcase®
HEALTH


2- حدد مواقع الأربع (4) كامات على الجانب الداخلي من وحدة الوسائط أحادية الجانب. أدِر قفل الكامة باستخدام مفكّ المسامير الملولبة ¼ دورة إلى اليسار لتحرير مسمار الربط.

3- أخرج الجزء العلوي (3a). أزل الأوتاد الخشبية واستبدلها (3b) إذا لزم الأمر.

4- قم بتركيب جزء علوي جديد عبر تثبيت أربعة (4) مسامير مصوملة ذات كامات أولاً في الفتحات الموجودة على الجانب السفلي من الجزء العلوي كما هو موضّح في الصفحة 3.

5- أعد تركيب اللوح الخلفي، الذي تمت إزالته في الخطوة 1 باستخدام غراء الخشب على الأوتاد الخشبية.

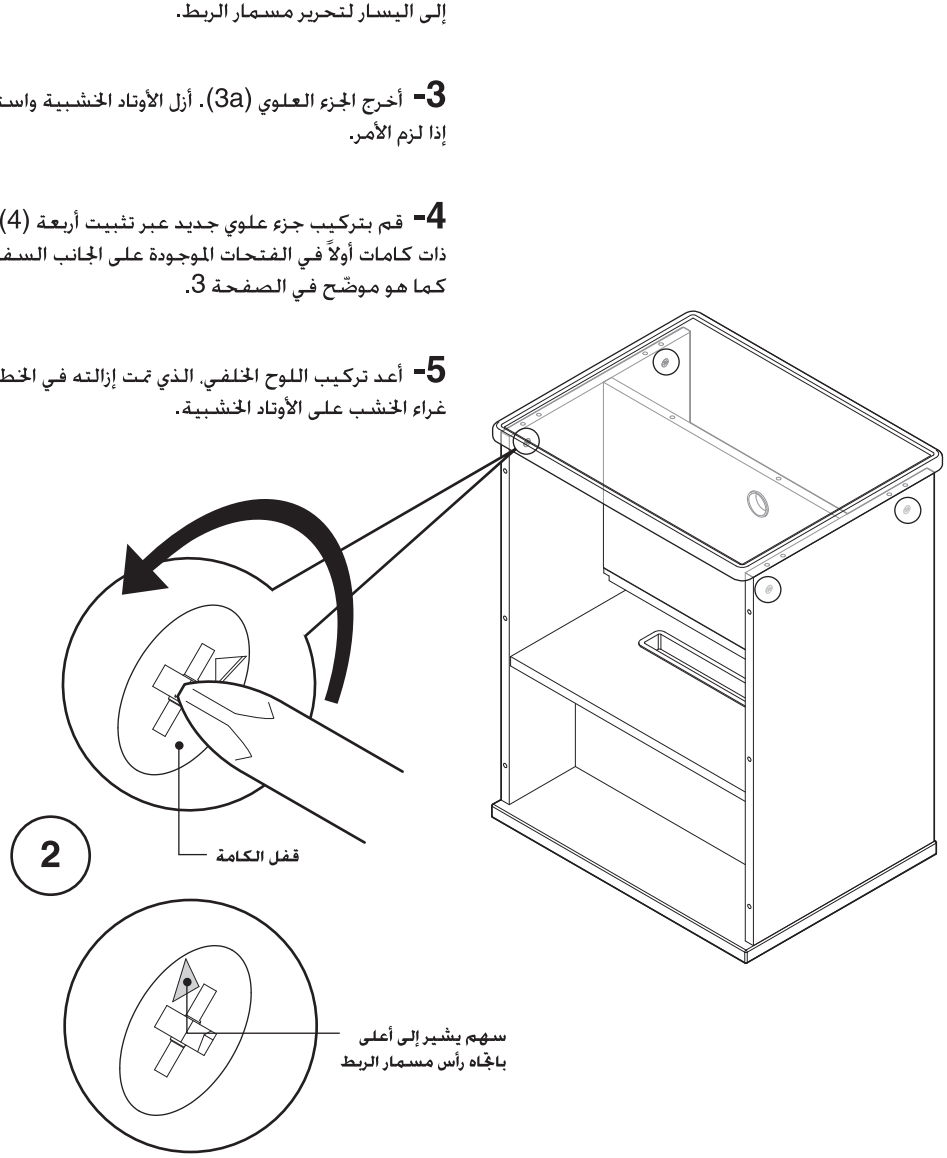

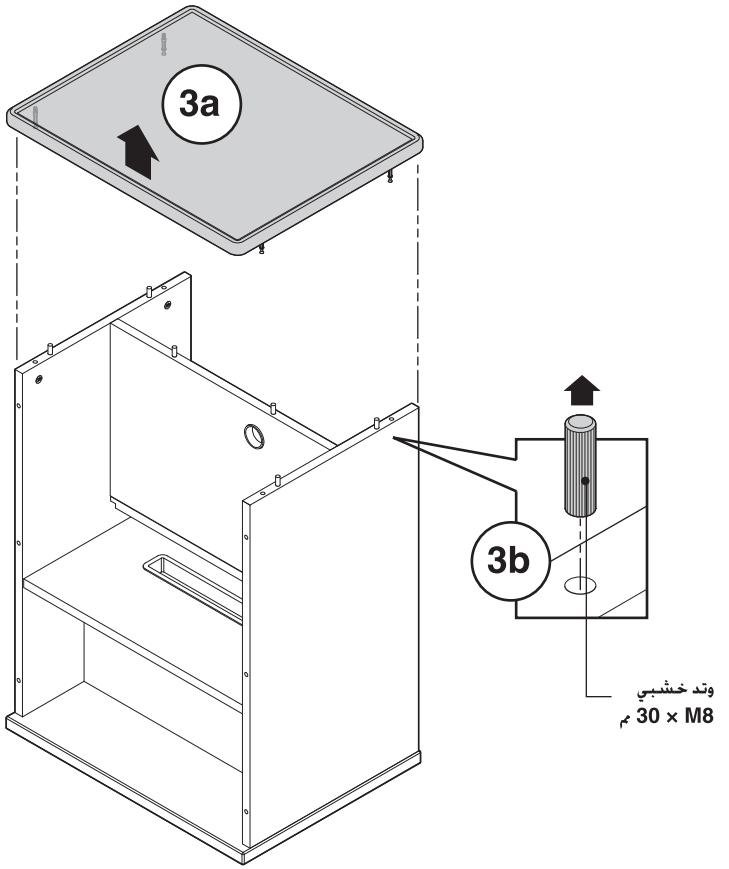

Steelcase®
HEALTH

إزالة الجزء العلوي من وحدة وسائط ثنائية الجانب

1- حدد مواقع الأربع (4) كامات على جانبيّ وحدة الوسائط ثنائية الجانب. أدِر قفل الكامة باستخدام مفكّ المسامير الملولبة 1/4 دورة إلى اليسار لتحرير مسمار الربط.

2- أخرج الجزء العلوي (2a). أزل الأوتاد الخشبية واستبدلها (2b) إذا لزم الأمر.

3- قم بتركيب جزء علوي جديد عبر تثبيت أربعة (4) مسامير مصوملة ذات كامات أولاً في الفتحات الموجودة على الجانب السفلي من الجزء العلوي كما هو موضّح في الصفحة 3.

