


Steelcase®
HEALTH

Reemplazo de una mesa en módulos isla, tipo enfermera o módulo media - Sonata™

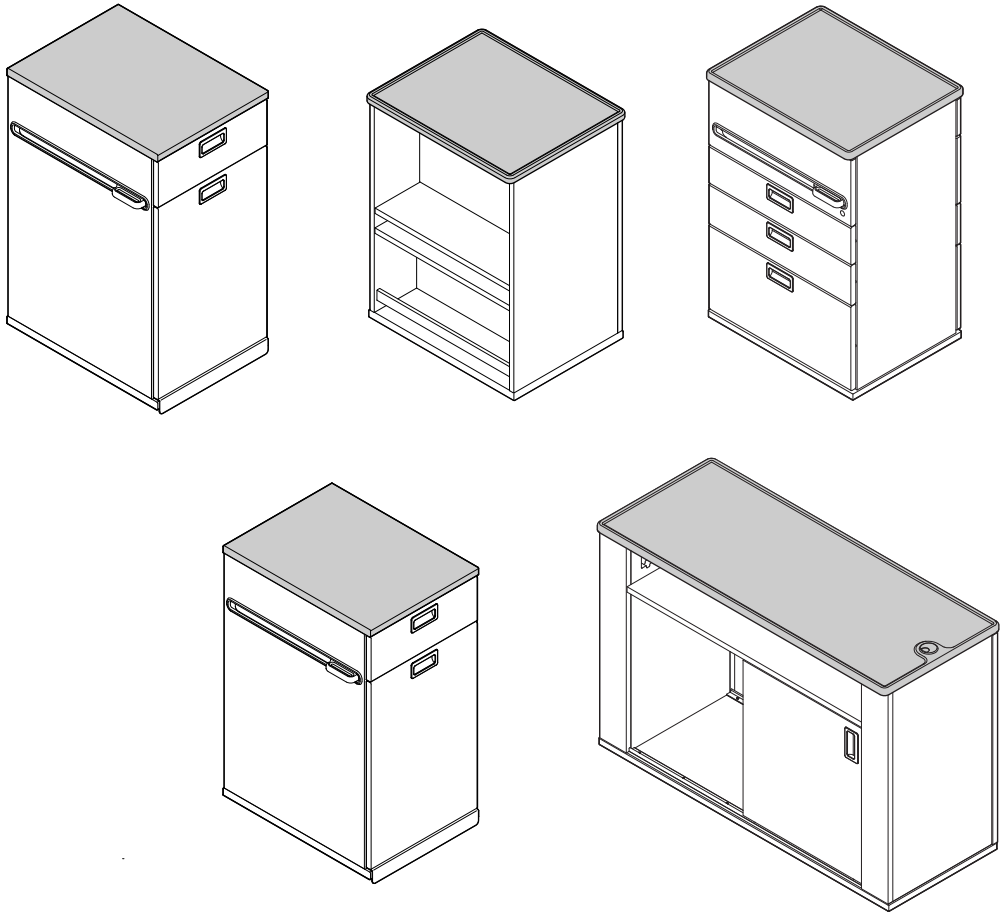






PEGAMENTO PARA MADERA

Si tiene problemas, preguntas o inquietudes, llame a su distribuidor local, o a Steelcase línea 1 al **888.STEELCASE** (888.783.3522) para obtener una acción inmediata de las personas que quieren ayudarle.
(Fuera de U.S.A., Canadá, México, Puerto Rico, y las islas Vírgenes Norteamericanas, llame al 1.616.247.2500) o visite nuestro sitio Web: www.steelcase.com
© 2014 Steelcase Inc.
Grand Rapids, MI 49501
Estados Unidos
Impreso en los Estados Unidos

Steelcase®
HEALTH

Retiro de la mesa de un módulo bandeja de enfermera de un solo lado

1. Retire el panel posterior (1a) luego retire las clavijas de madera restantes (1b).

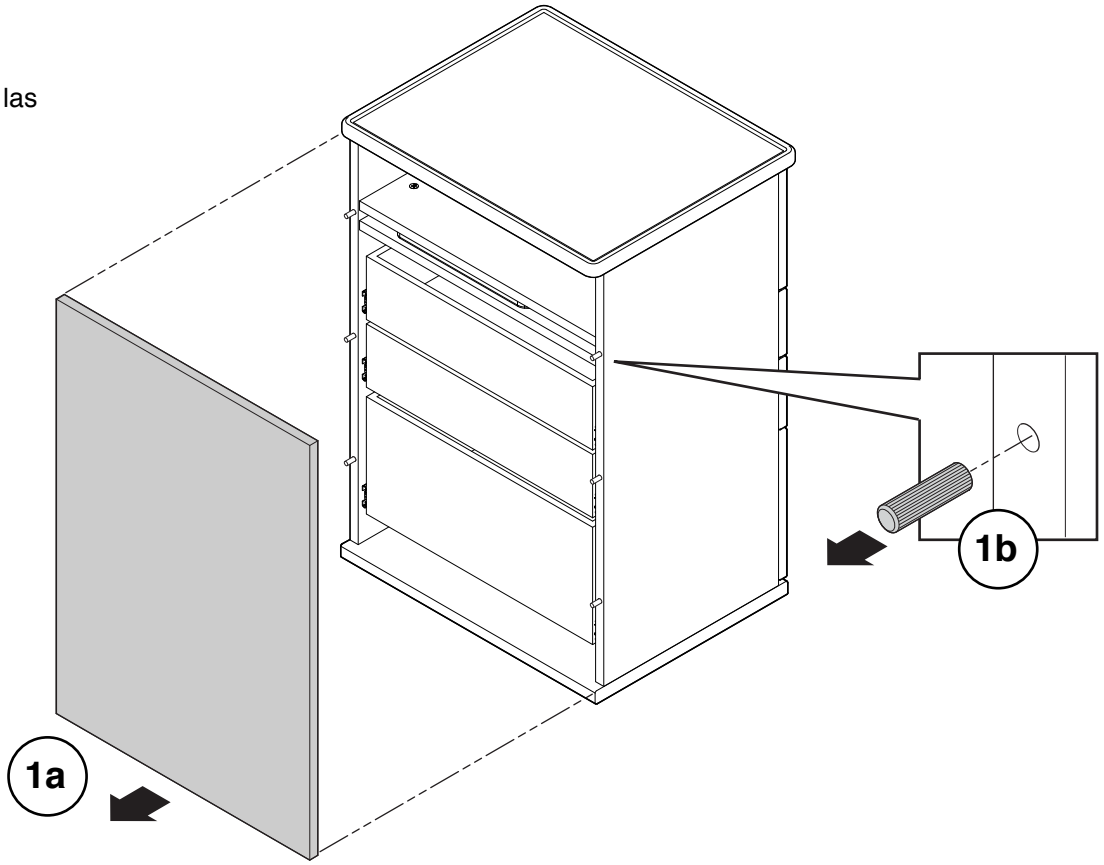


Steelcase®
HEALTH


2. Localice las cuatro (4) levas de la parte del interior de la bandeja de enfermera de un lado. Gire el bloqueo de leva con un destornillador ¼ de vuelta hacia la izquierda para soltar el tornillo conector.


3. Retire la mesa (3a). Retire y vuelva a colocar las clavijas de madera (3b) si es necesario.


4. Instale una nueva mesa instalando primero cuatro (4) tornillos de la leva en los orificios de la parte inferior de la mesa.

5. Vuelva a colocar el panel, retirado en el paso 1, colocando pegamento en las clavijas de madera.

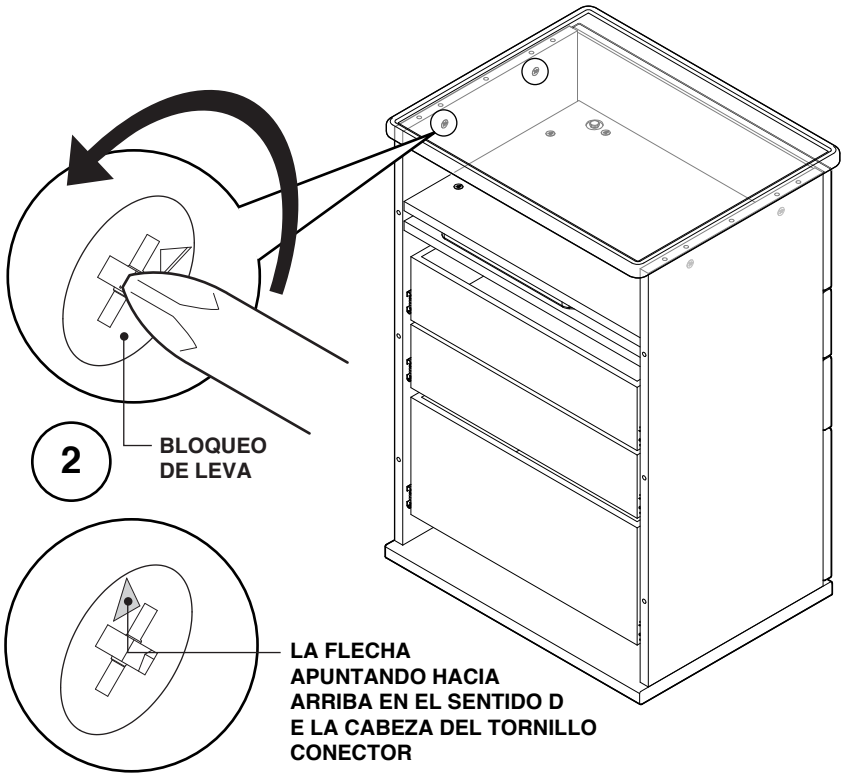

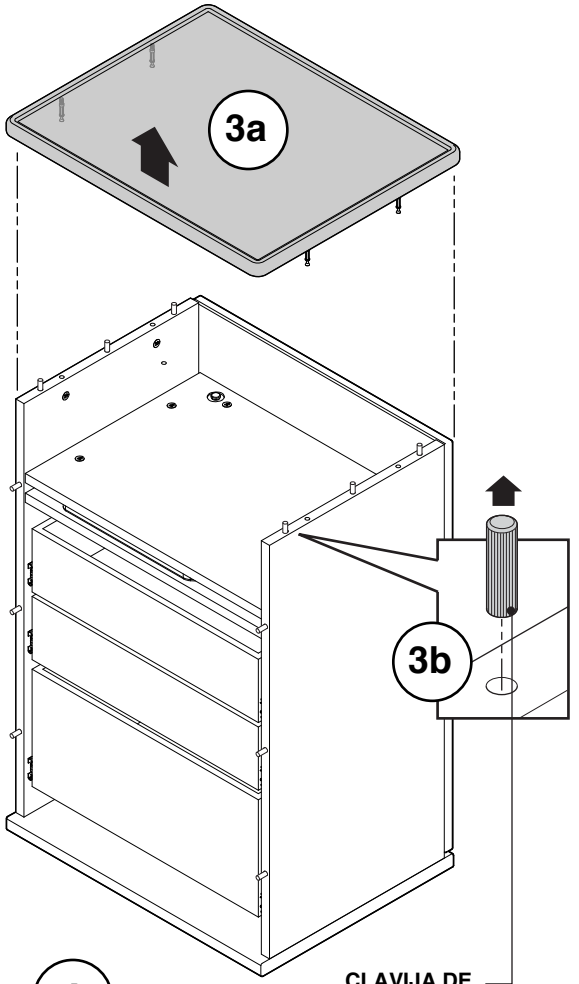

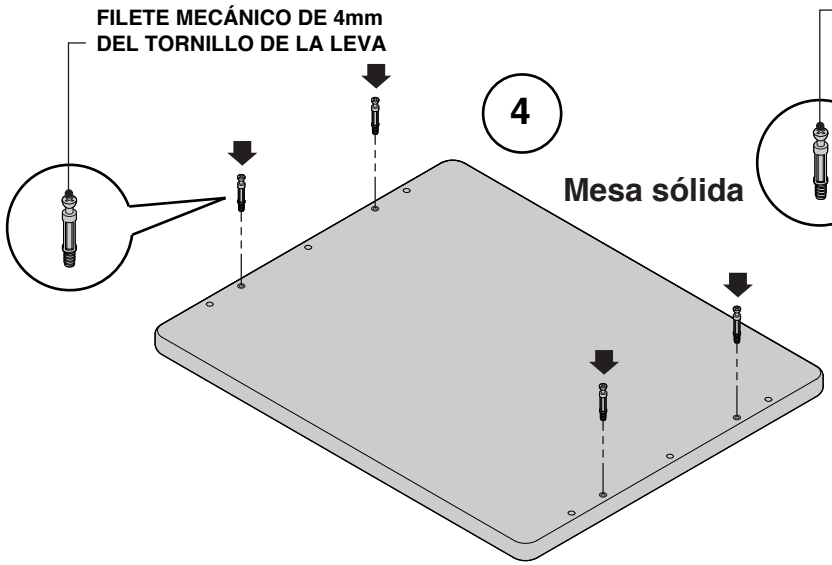

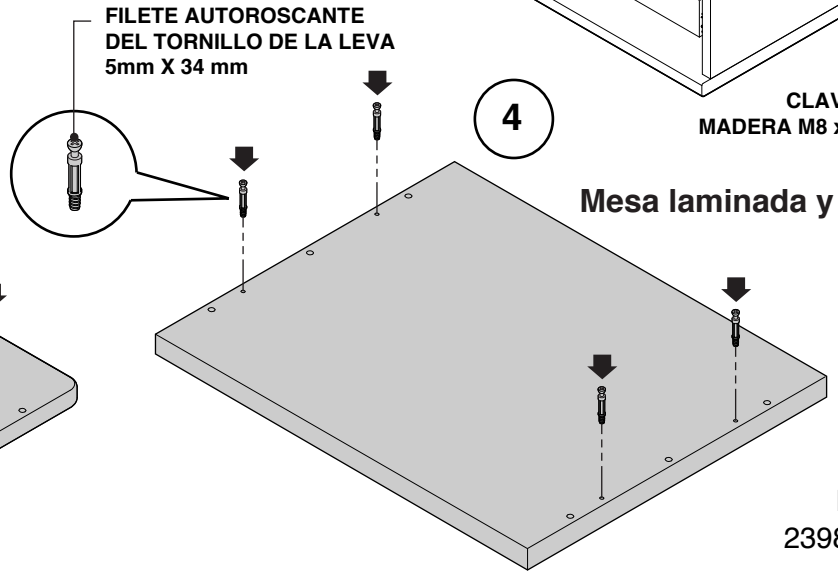

Steelcase®
HEALTH


Retiro de la mesa de un módulo bandeja de enfermera de dos lados

1. Empuje sobre la aleta en ambos lados del cajón y retire el cajón superior.

2. Localice las cuatro (4) levas de los lados de la bandeja de enfermera. Gire el bloqueo de leva con un destornillador ¼ de vuelta hacia la izquierda para soltar el tornillo conector.

3. Retire la mesa (3a). Retire y vuelva a colocar las clavijas de madera (3b) si es necesario.

4. Instale una nueva mesa instalando primero cuatro (4) tornillos de la leva en los orificios de la parte inferior de la mesa como se muestra en la página 3.

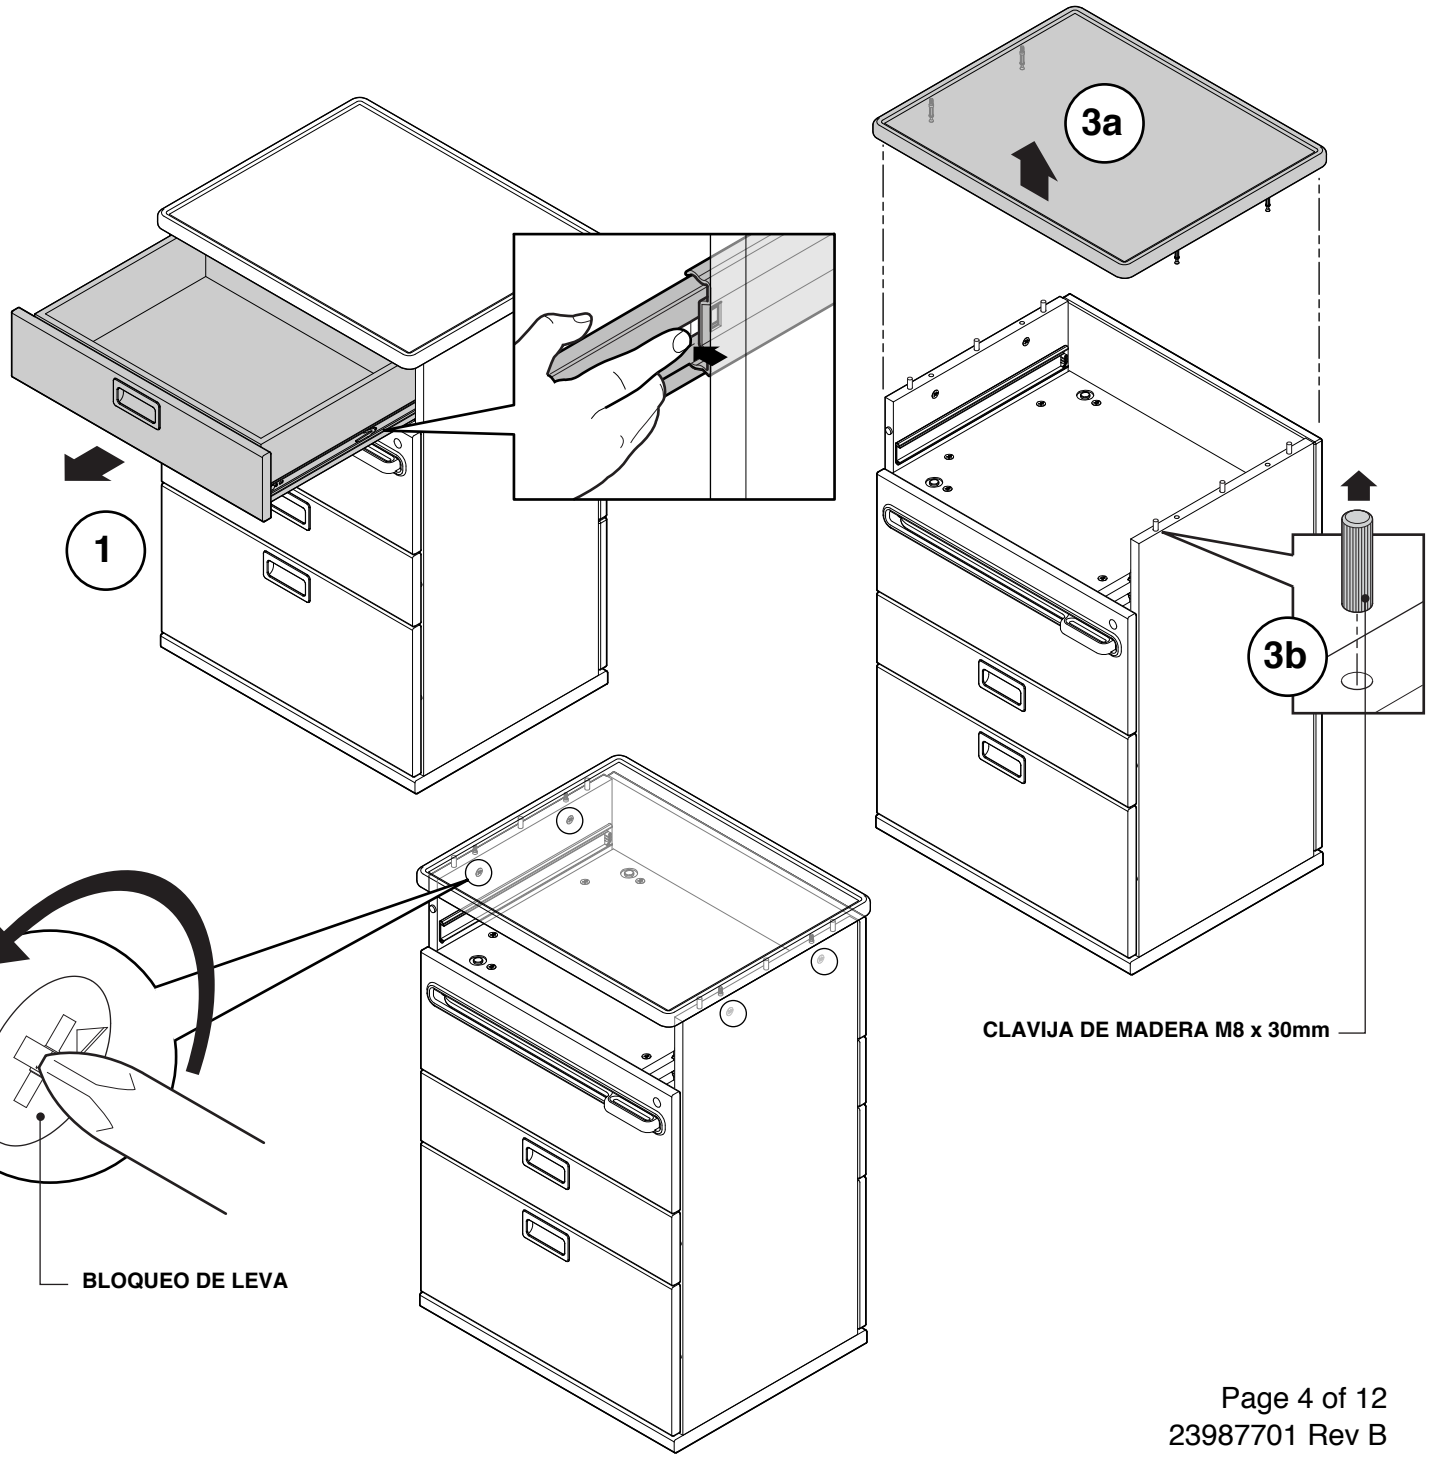

Steelcase®
HEALTH


Retiro de la mesa de un módulo bandeja de enfermera con basurero


1. Empuje sobre la aleta en ambos lados del cajón y retire el cajón superior.


2. Localice las cinco (5) levas de los lados y parte posterior de la bandeja de enfermera. Gire el bloqueo de leva con un destornillador ¼ de vuelta hacia la izquierda para soltar el tornillo conector.

3. Retire la mesa (3a). Retire y vuelva a colocar las clavijas de madera (3b) si es necesario.

4. Instale una nueva mesa instalando primero cinco (5) tornillos de la leva en los orificios de la parte inferior de la mesa como se muestra en la página 3.

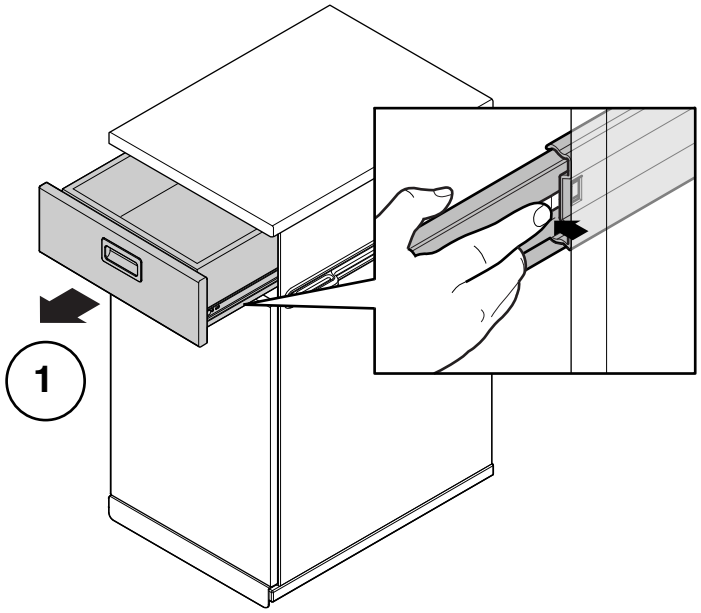

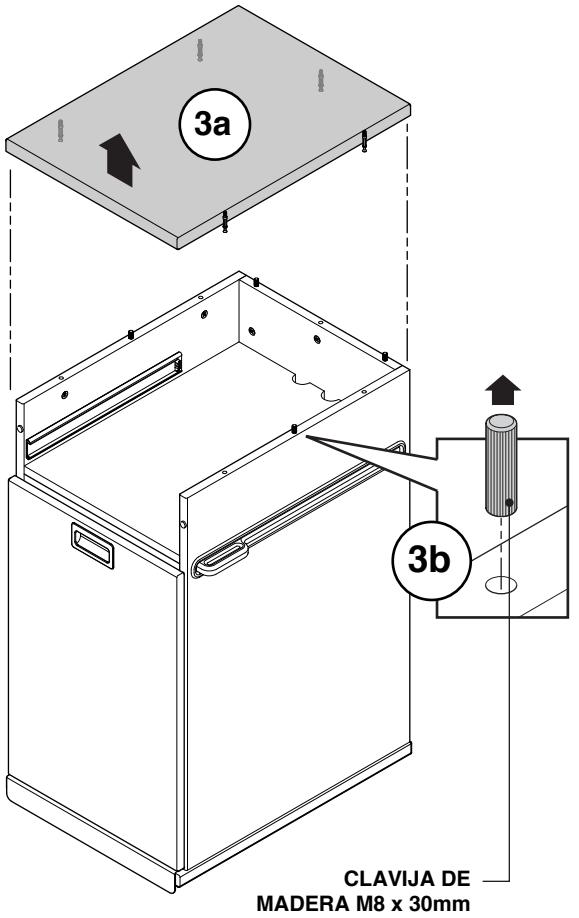

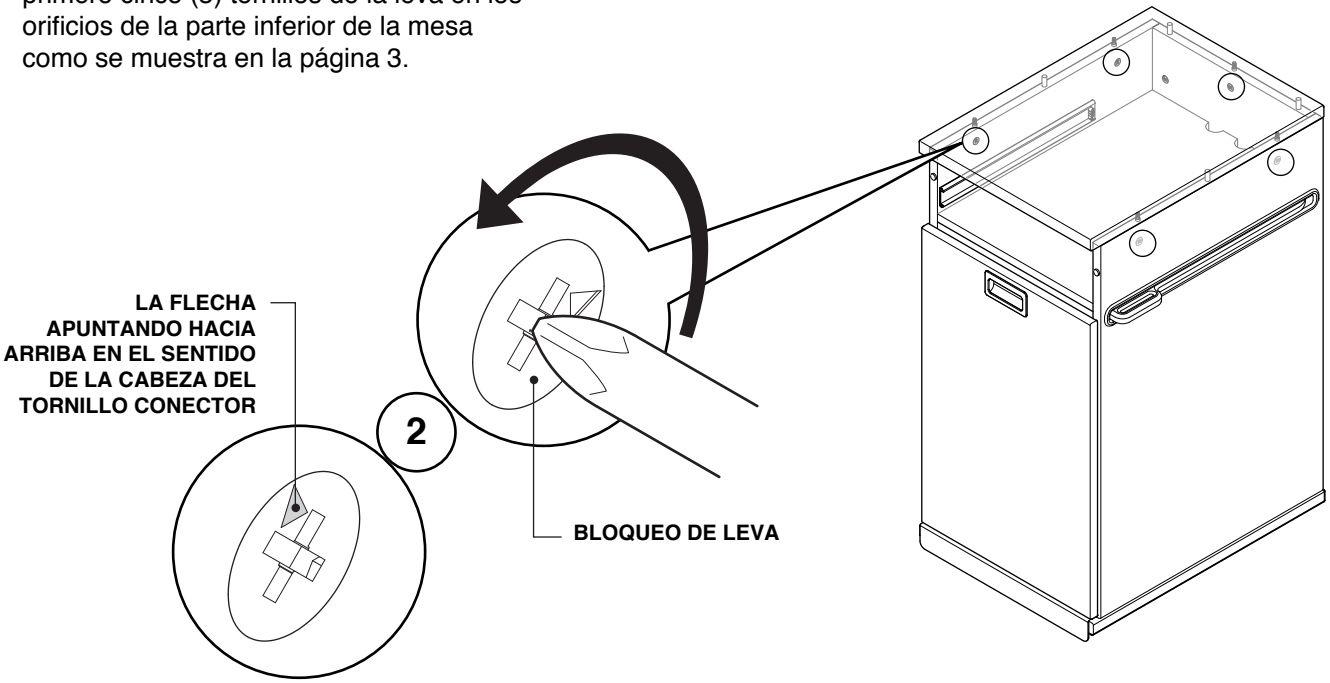


Steelcase®
HEALTH

Retiro de la mesa de un módulo isla de dos lados

1. Localice las cuatro (4) levas del interior del módulo isla. Gire el bloqueo de leva con un destornillador ¼ de vuelta hacia la izquierda para soltar el tornillo conector.

2. Retire la mesa (2a). Retire y vuelva a colocar las clavijas de madera (2b) si es necesario.

3. Instale una nueva mesa instalando primero cuatro (4) tornillos de leva en los orificios de la parte inferior de la mesa como se muestra en la página 3.

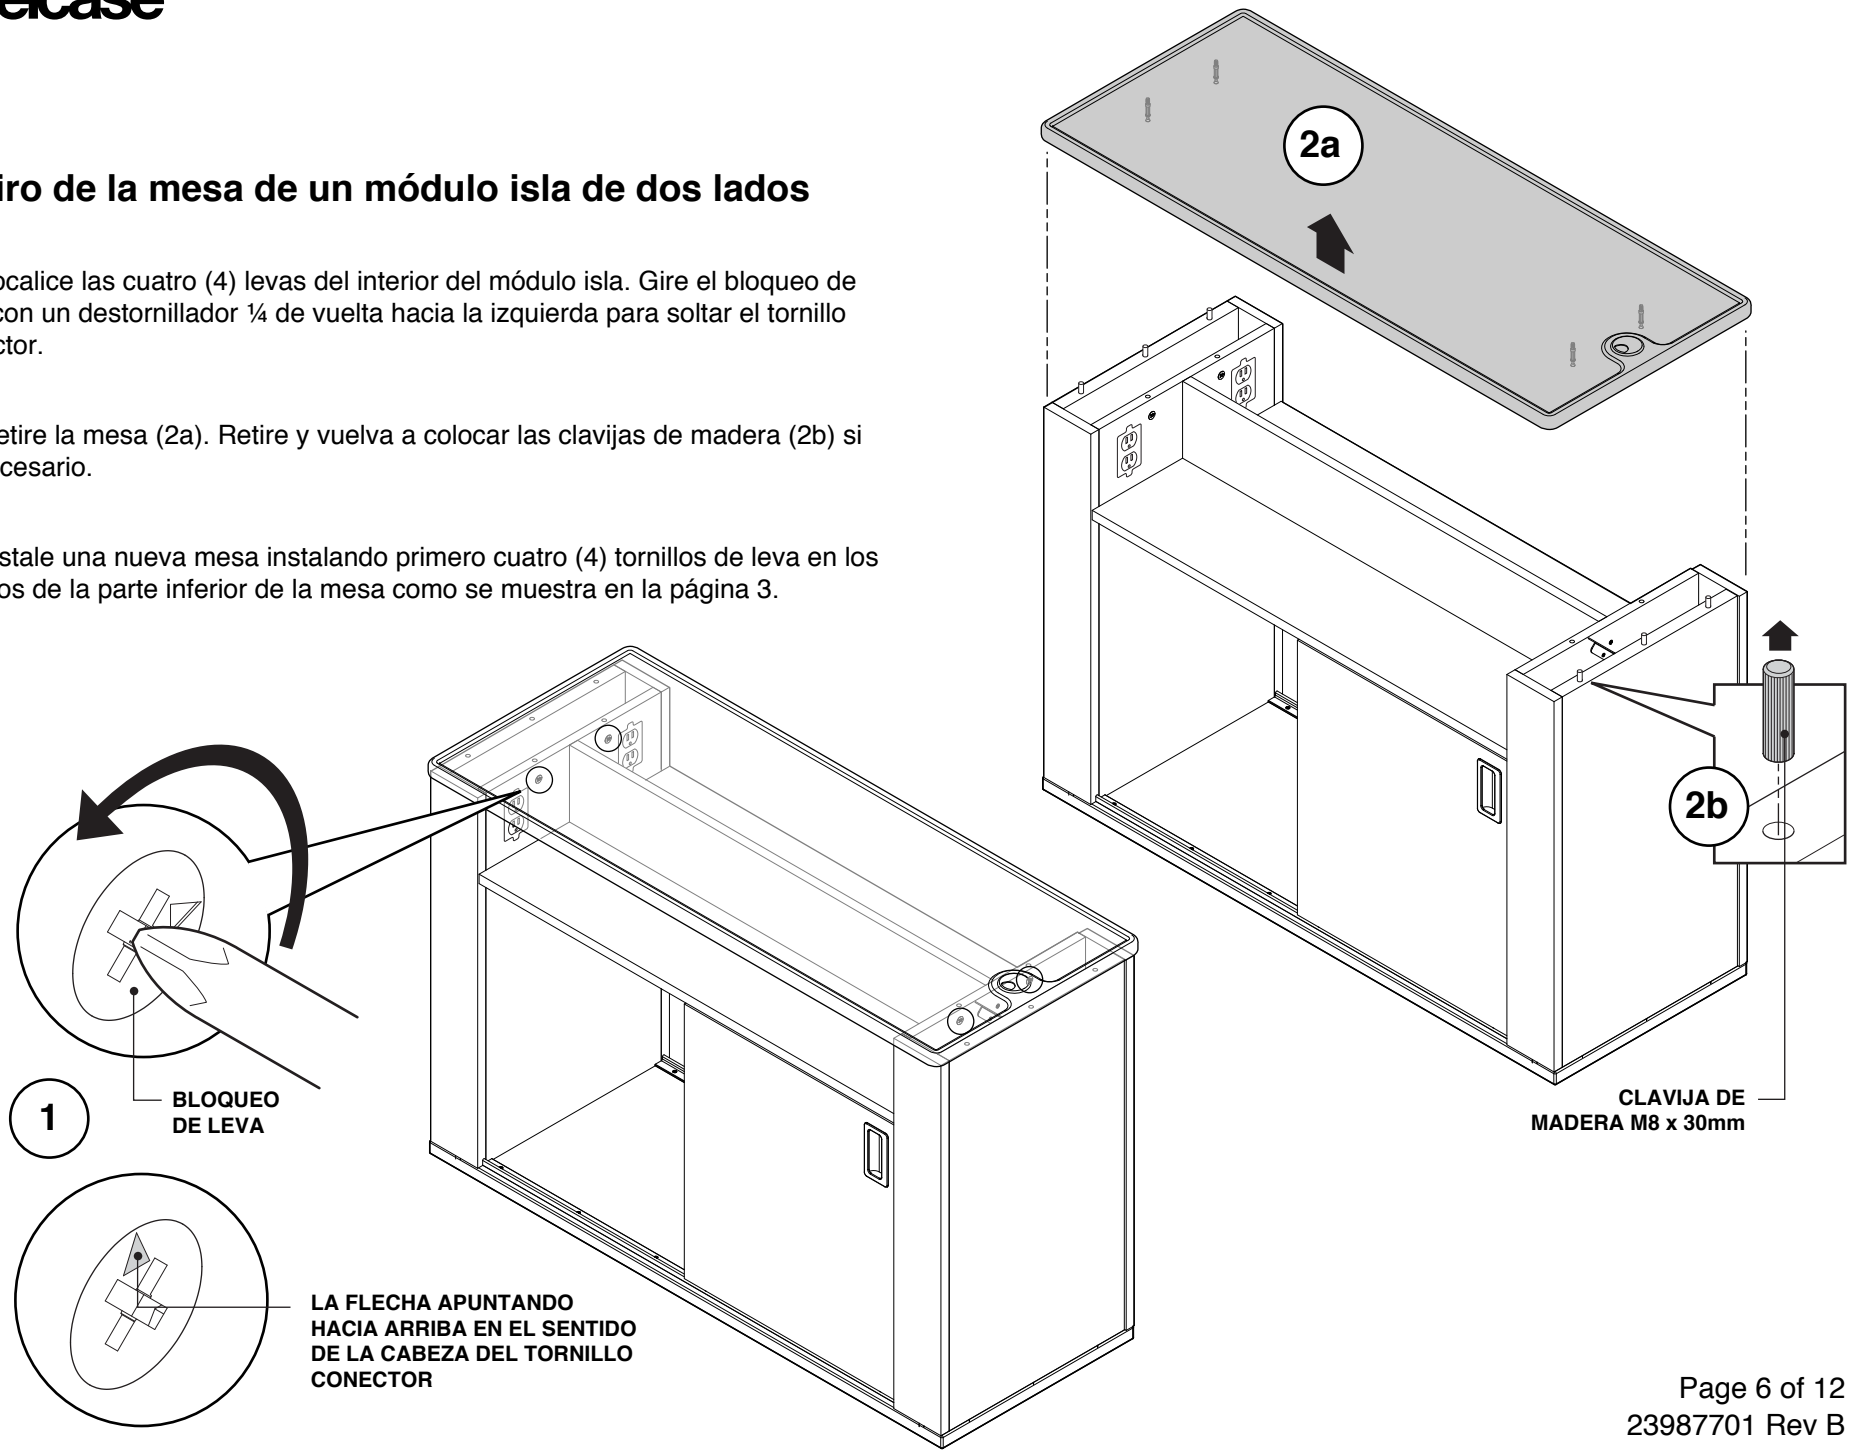


Steelcase®
HEALTH


Retiro de la mesa de un módulo isla de 36 pulgadas de dos lados

1. Localice las cuatro (4) levas del interior del módulo isla. Gire el bloqueo de leva con un destornillador ¼ de vuelta hacia la izquierda para soltar el tornillo conector.

2. Retire la mesa (2a). Retire y vuelva a colocar las clavijas de madera (2b) si es necesario.

3. Instale una nueva mesa instalando primero cuatro (4) tornillos de leva en los orificios de la parte inferior de la mesa como se muestra en la página 3.

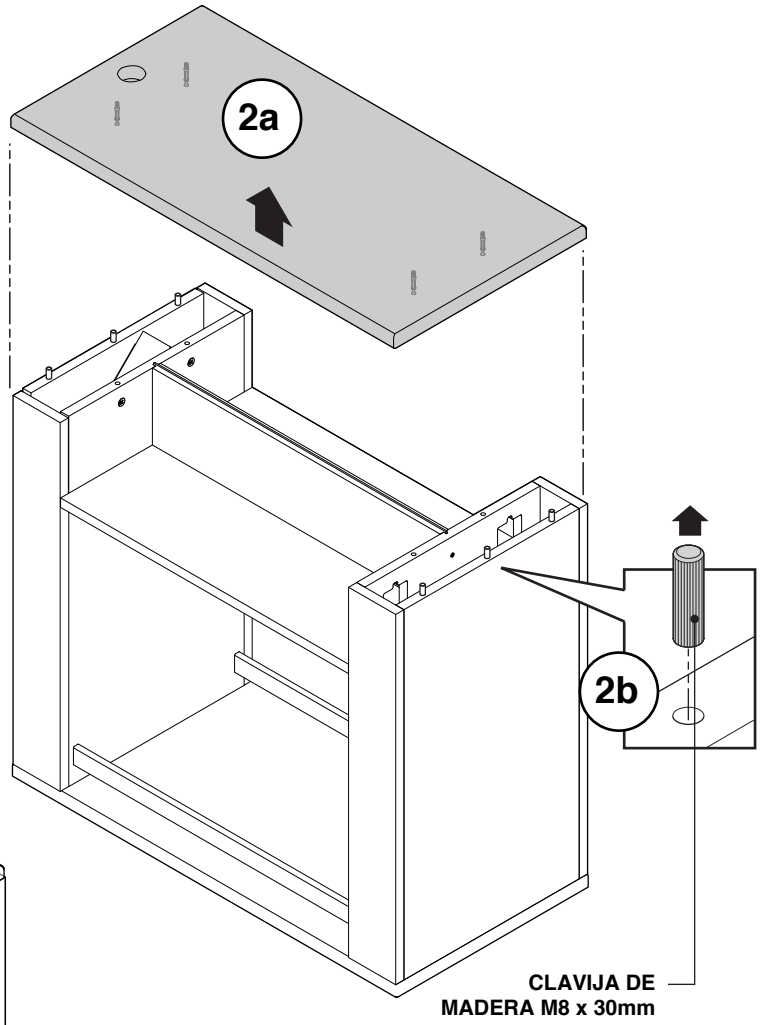

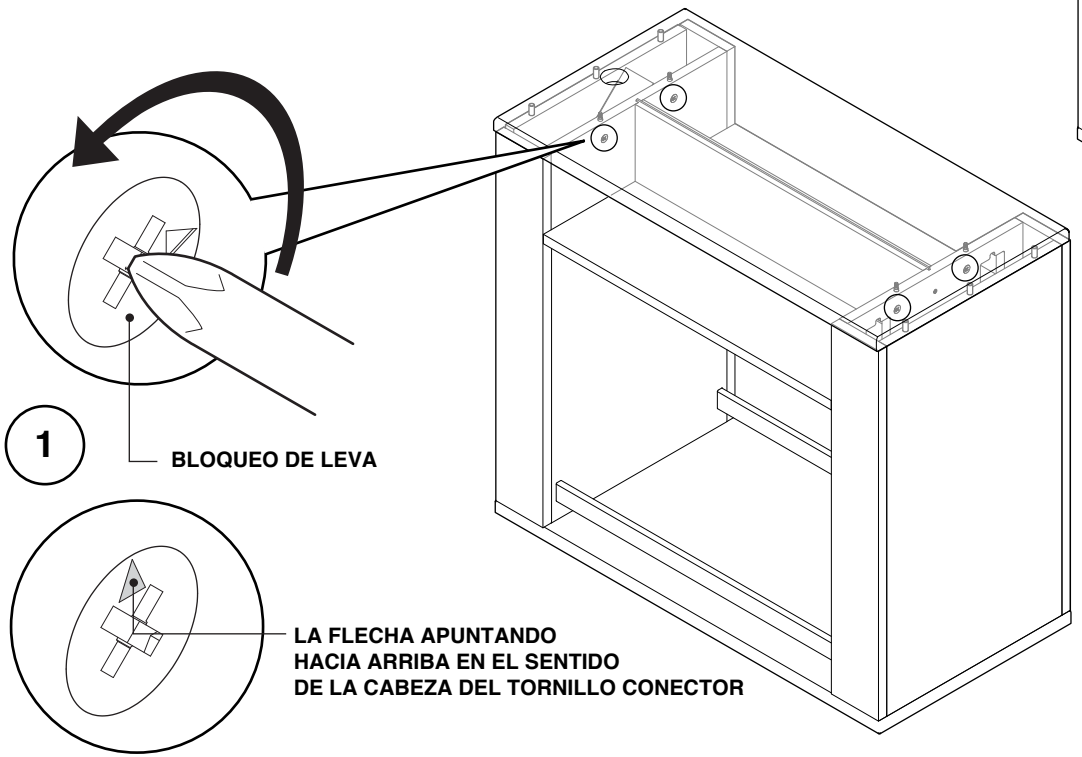


Steelcase®
HEALTH

Retiro de la mesa de un módulo isla de un solo lado

1. Localice las cuatro (4) levas del interior del módulo isla de un lado. Gire el bloqueo de leva con un destornillador ¼ de vuelta hacia la izquierda para soltar el tornillo conector.

2. Retire la mesa (2a). Retire y vuelva a colocar las clavijas de madera (2b) si es necesario.

3. Instale una nueva mesa instalando primero cuatro (4) tornillos de leva en los orificios de la parte inferior de la mesa como se muestra en la página 3.

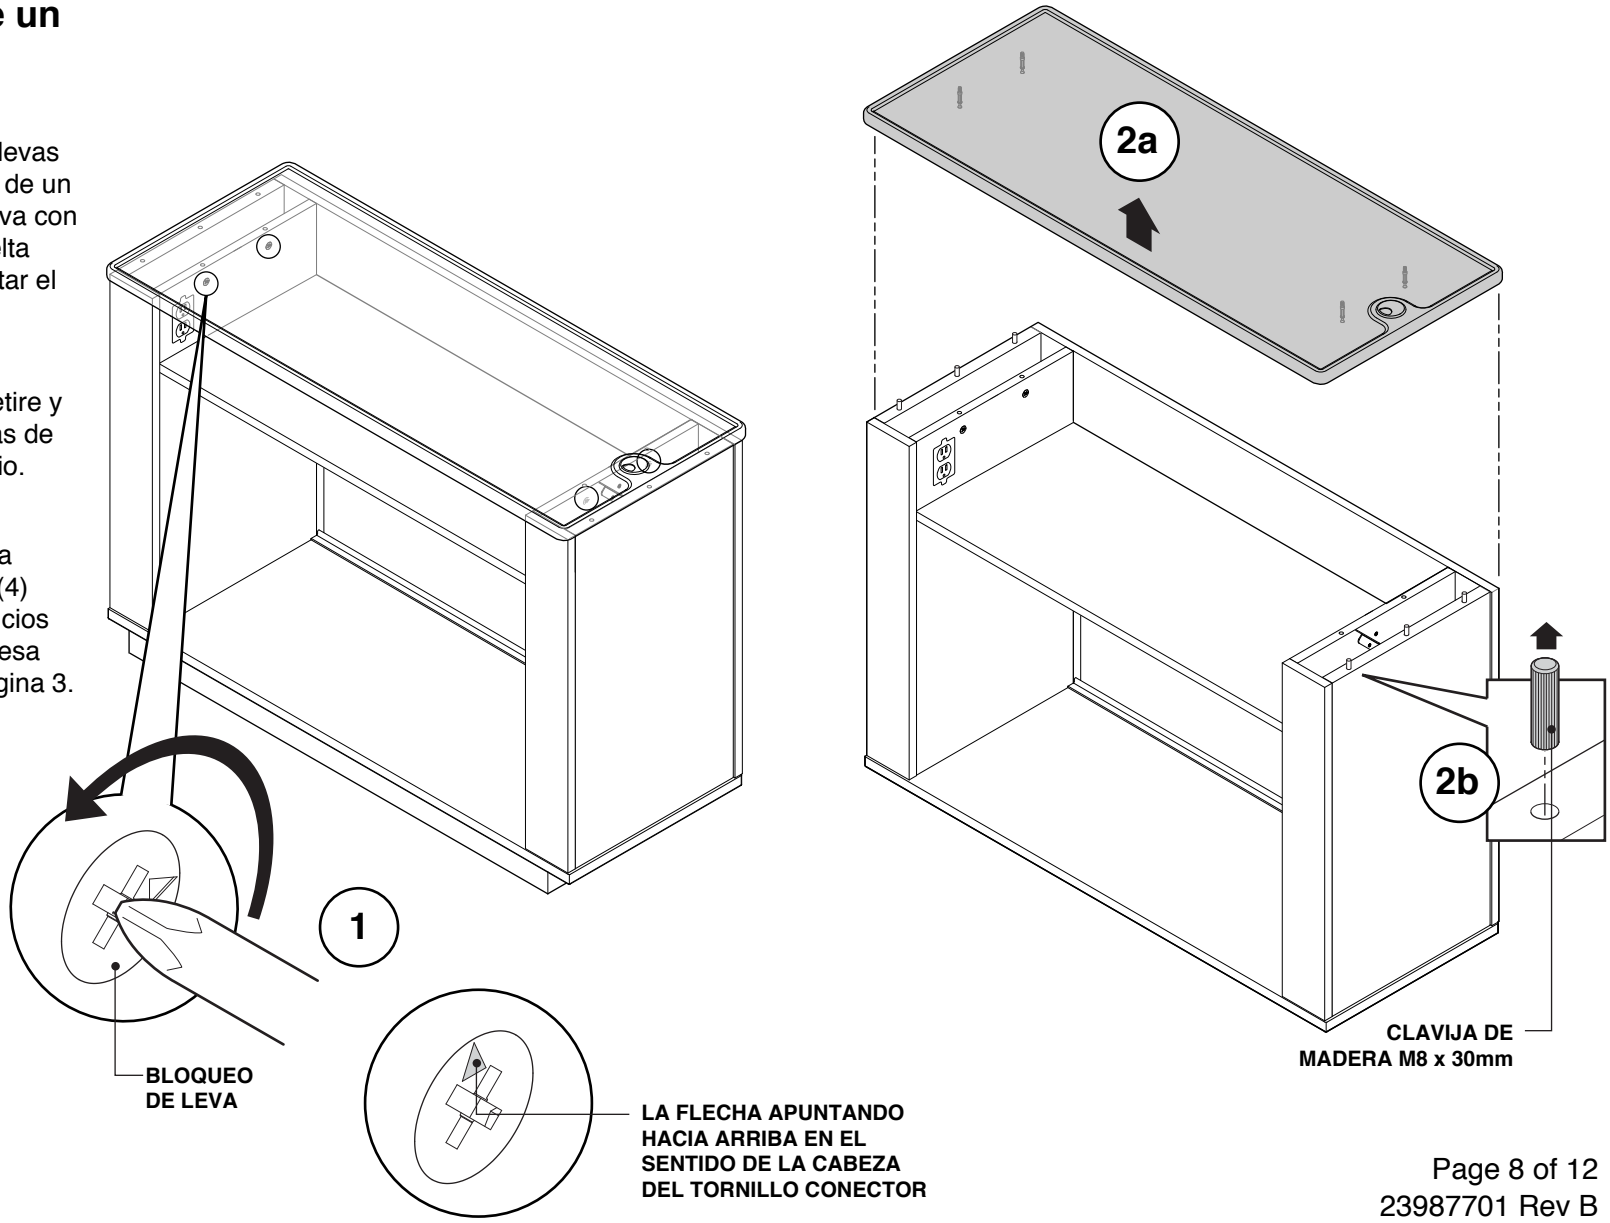


Steelcase®
HEALTH

Retiro de la mesa de un módulo isla de 36 pulgadas de un solo lado

1. Localice las cuatro (4) levas del interior del módulo isla de 36 pulgadas de un lado. Gire el bloqueo de leva con un destornillador ¼ de vuelta hacia la izquierda para soltar el tornillo conector.

2. Retire la mesa (2a). Retire y vuelva a colocar las clavijas de madera (2b) si es necesario.


3. Instale una nueva mesa instalando primero cuatro (4) tornillos de leva en los orificios de la parte inferior de la mesa como se muestra en la página 3.

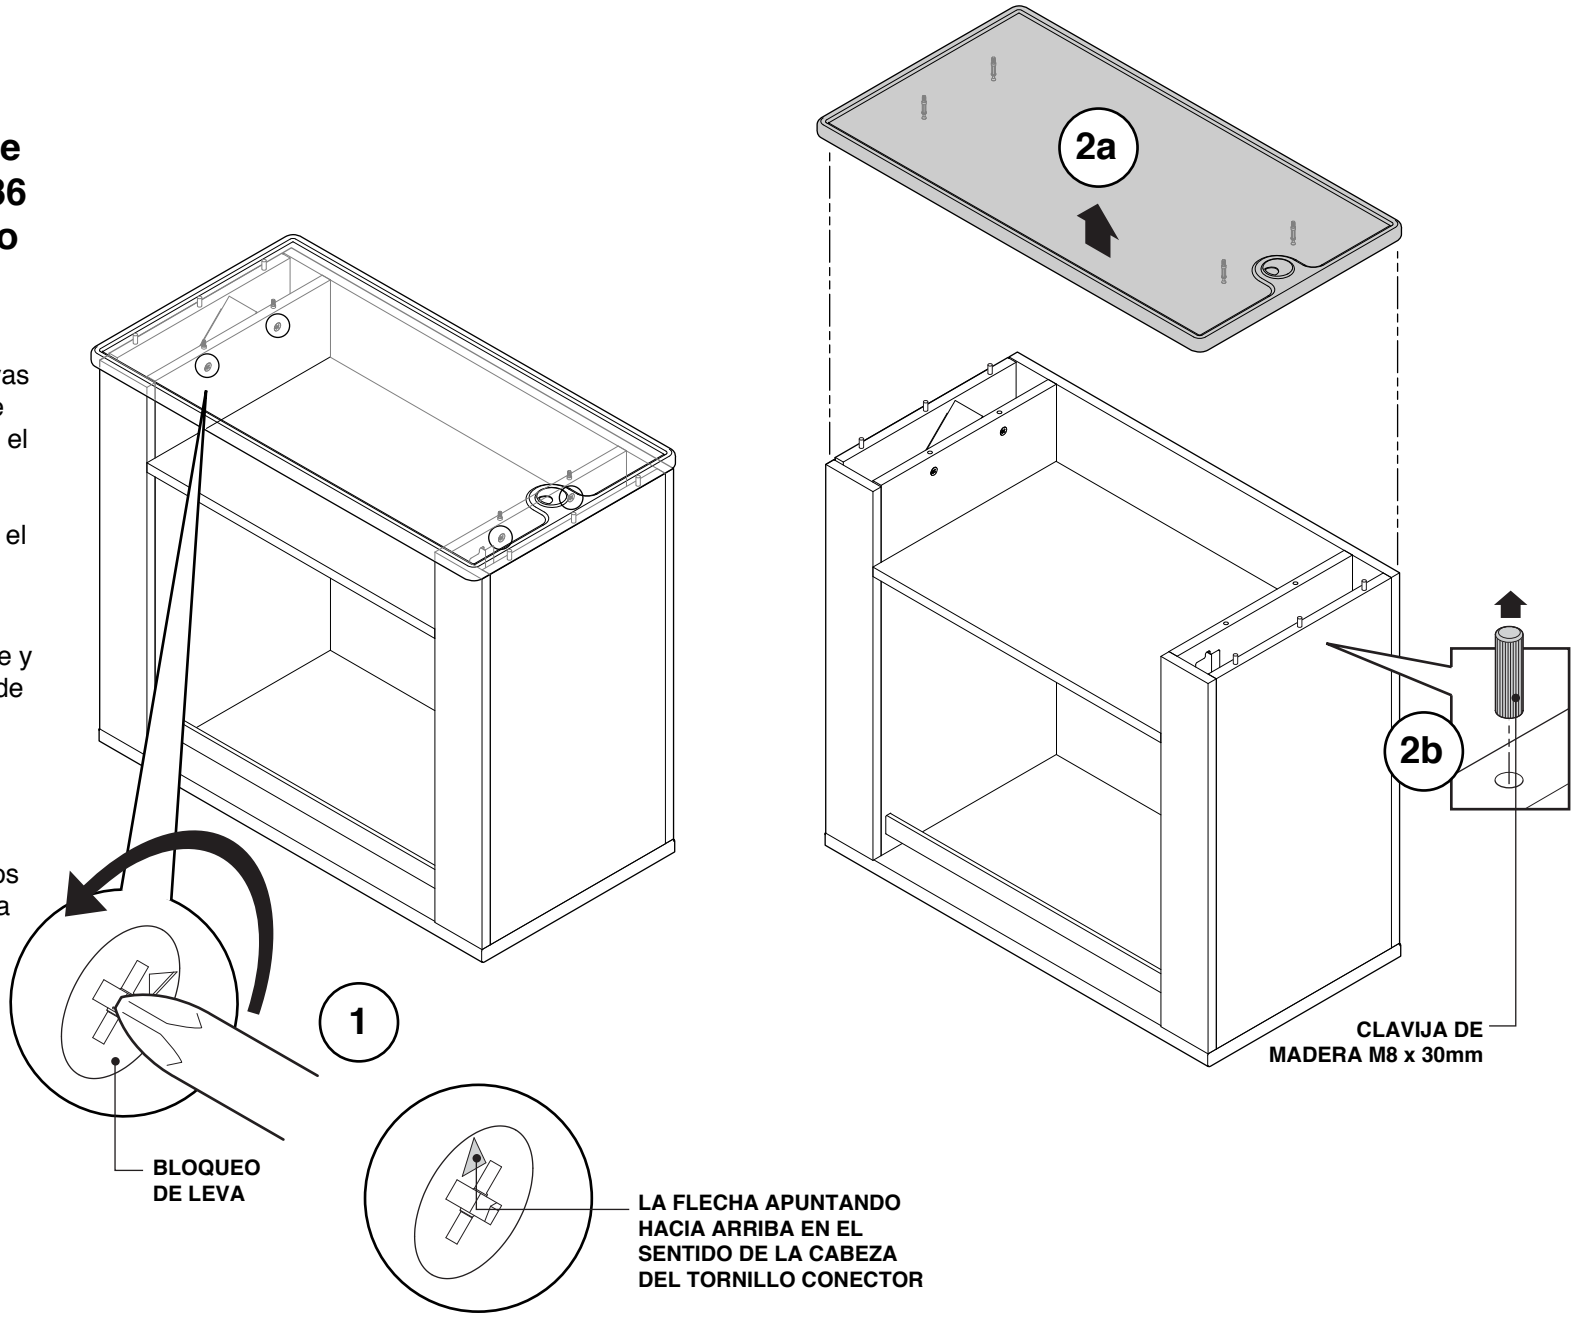

Steelcase®
HEALTH

Retiro de la mesa de un módulo media de un solo lado

1. Retire el panel posterior (1a), luego retire las clavijas de madera restantes (1b).

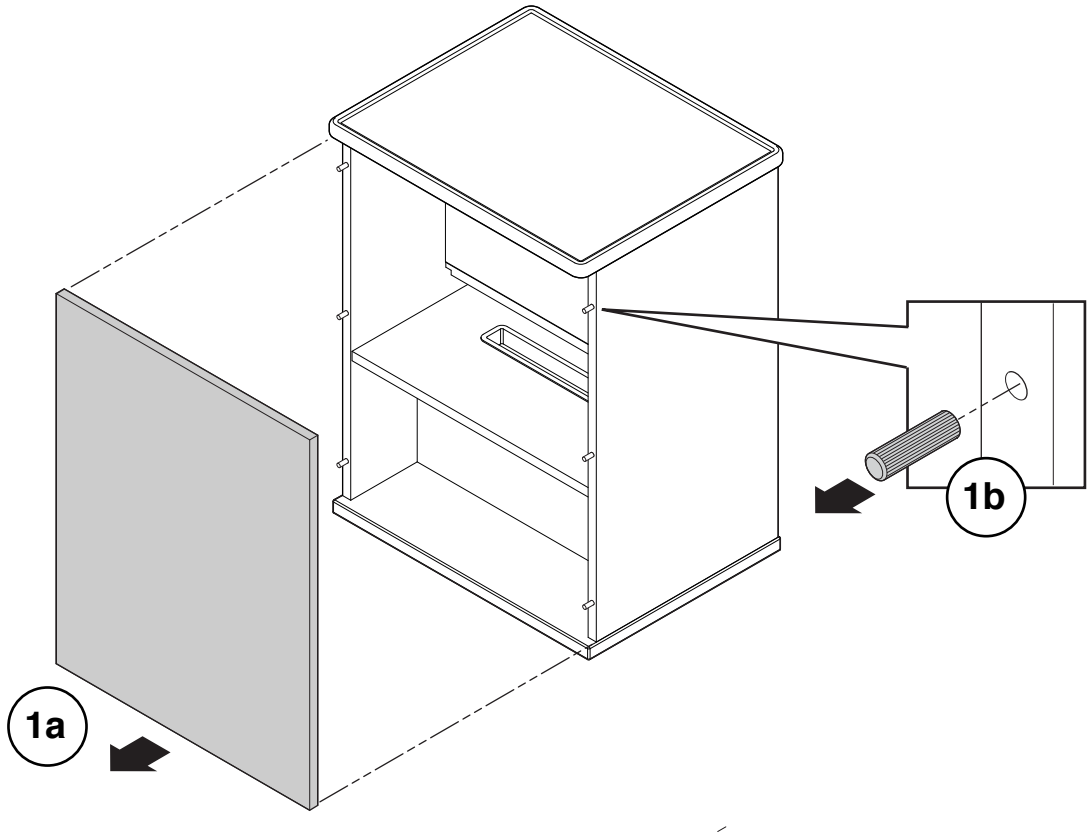


Steelcase®
HEALTH

2. Localice las cuatro (4) levas del interior del módulo media de un lado. Gire el bloqueo de leva con un destornillador ¼ de vuelta hacia la izquierda para soltar el tornillo conector.

3. Retire la mesa (3a). Retire y vuelva a colocar las clavijas de madera (3b) si es necesario.

4. Instale una nueva mesa instalando primero cuatro (4) tornillos de leva en los orificios de la parte inferior de la mesa como se muestra en la página 3.

5. Vuelva a colocar el panel posterior retirado en el paso 1, use pegamento en las clavijas de madera.

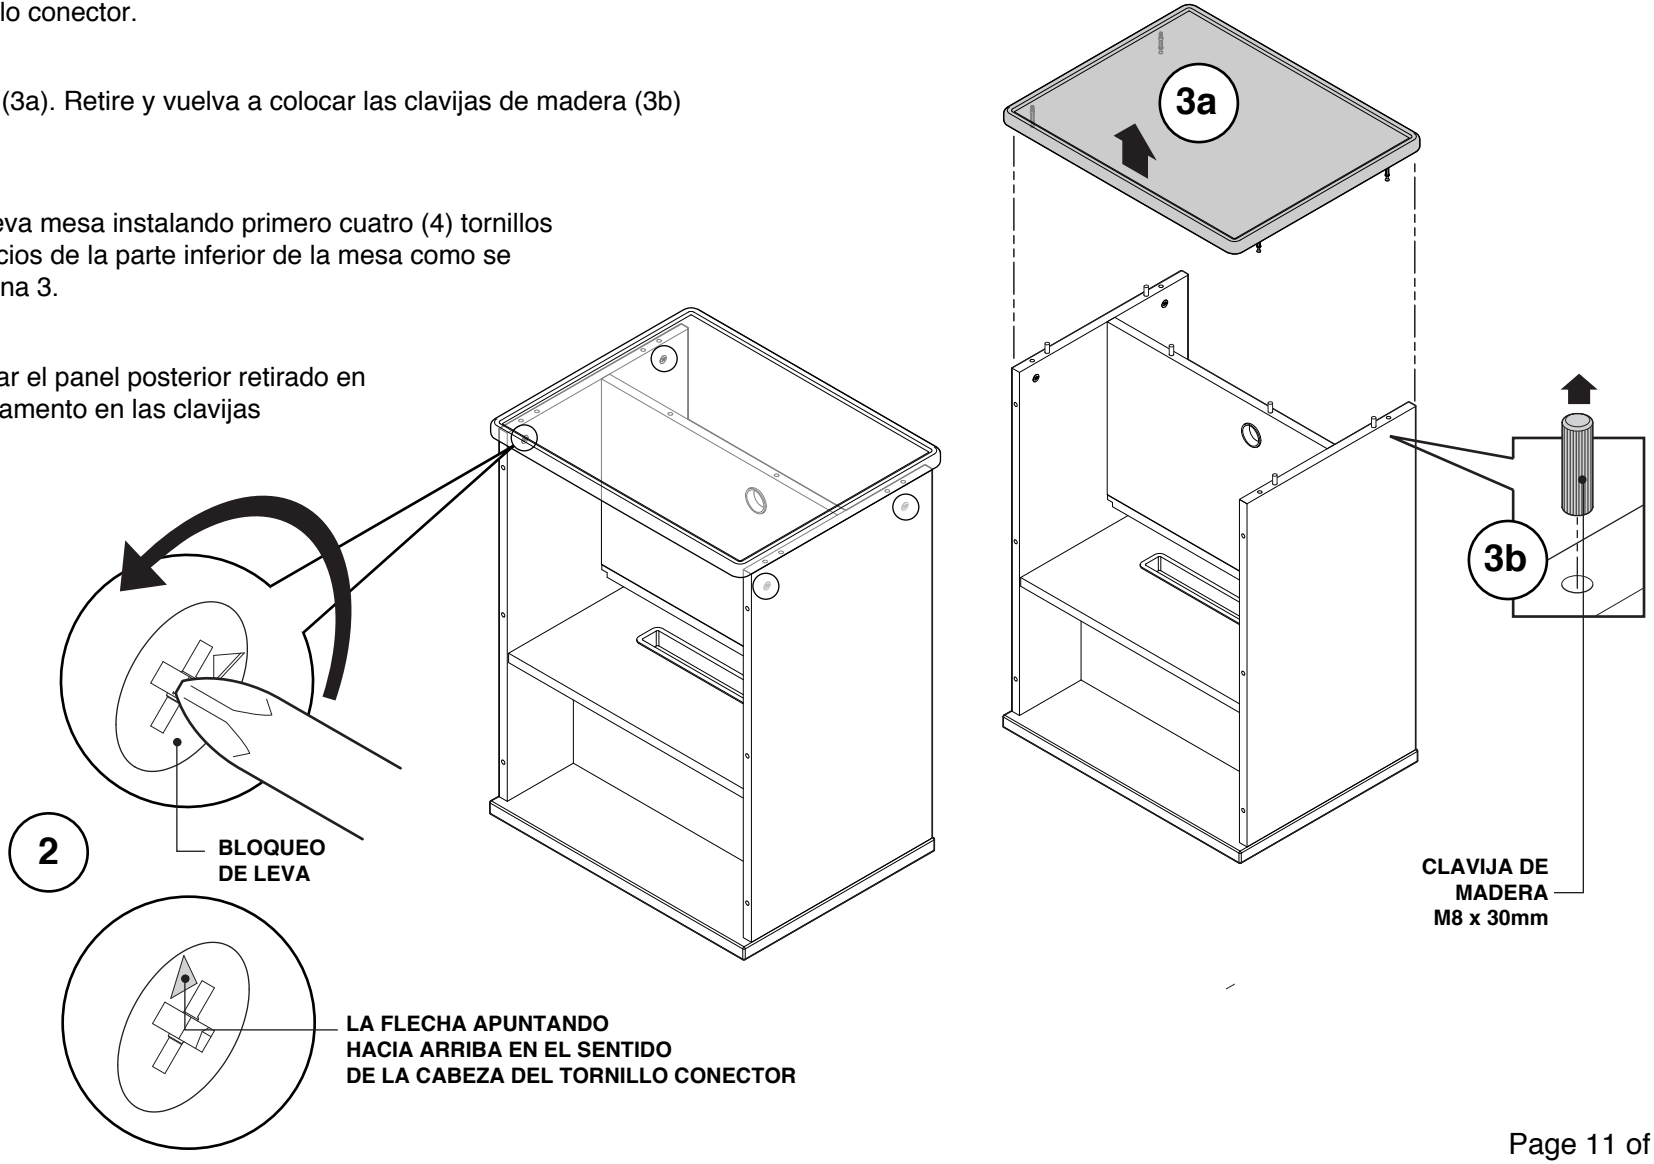

Steelcase®
HEALTH

Retiro de la mesa de un módulo media de dos lados

1. Localice las cuatro (4) levas de los lados del módulo media de dos lados. Gire el bloqueo de leva con un destornillador ¼ de vuelta hacia la izquierda para soltar el tornillo conector.

2. Retire la mesa (2a). Retire y vuelva a colocar las clavijas de madera (2b) si es necesario.

3. Instale una nueva mesa instalando primero cuatro (4) tornillos de leva en los orificios de la parte inferior de la mesa como se muestra en la página 3.

