
Steelcase®
HEALTH

مشابك تعليق المعاطف Opus™



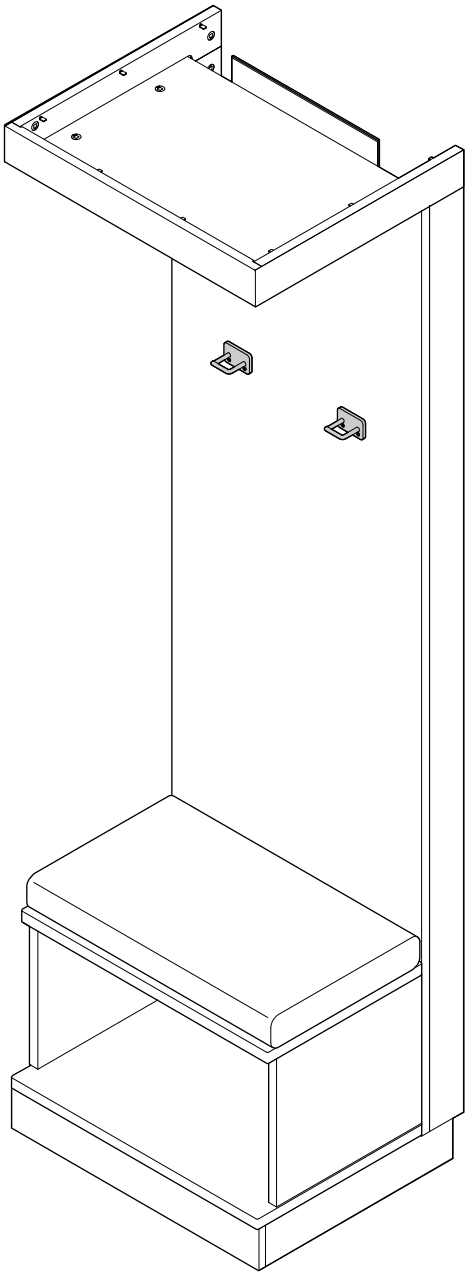

23987102 النسخة المنقحة ب

إذا كانت لديك أية مشكلة أو سؤال أو طلب، اتصل بالتاجر المحلي لديك أو بالخط الأول لشركة Steelcase على الخط المجاني **888.STEELCASE** (888.783.3522) للحصول على استجابة فورية من الأشخاص الراغبين في مساعدتك.

(خارج الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك وبورتوريكو وجزر فرجن التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، يرجى الاتصال على الرقم: 1.616.247.2500) أو زيارة موقعنا الإلكتروني: www.steelcase.com

© جميع الحقوق لعام 2007 محفوظة لشركة Steelcase Inc.
جراند رابيدز، ميتشجن 49501
الولايات المتحدة الأمريكية

طُبع في الولايات المتحدة الأمريكية

Steelcase®
HEALTH

1- باستخدام قلم رصاص وشريط قياس، حدد الارتفاع المطلوب لمواقع مشابك تعليق المعاطف.


2- ضع علامة على خط المنتصف في الموقع المطلوب بكل جانبٍ من وحدة القاعدة.

3- قم بمحاذاة الجزء العلوي لمشبك تعليق المعاطف مع العلامة الأفقية التي حددتها بالقلم الرصاص وضع مشبك تعليق المعاطف بحيث يكون في منتصف العلامة الرأسية التي حددتها بالقلم الرصاص. ضع علامات على الفتحات باستخدام قلم رصاص.

4- أزل مشبك تعليق المعاطف واثقب فتحتين دليليتين (2) بقطر 3/32 بوصة لكل مشبك.

تلميح: امسح العلامات التي حددتها بالقلم الرصاص عند هذه المرحلة.

5- قم بتركيب مشابك تعليق المعاطف بوحدة القاعدة باستخدام المسمارين (2) الملولبين المتوفرين لكل مشبك.

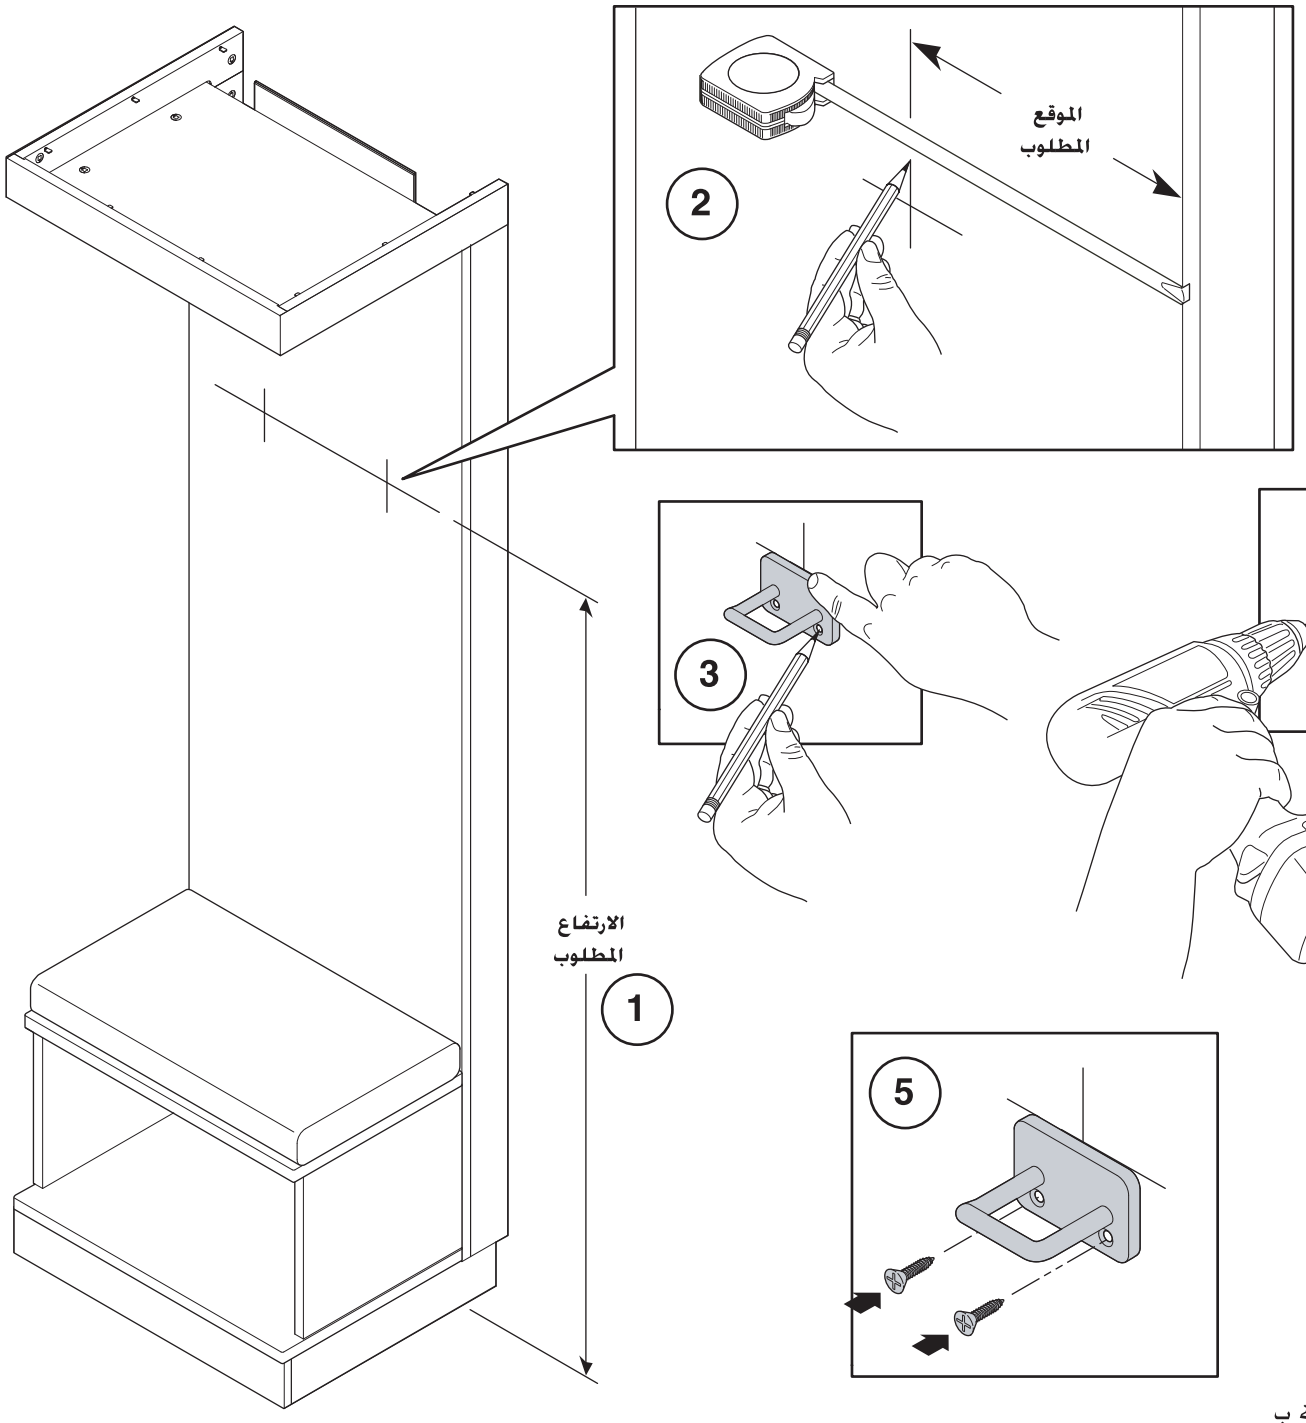

23987102 النسخة المنقحة ب